

Martin Christ GmbH
LSCplus
Batchdaten 24091001.00



Aufzeichnungsdatei: 24091001.00
Aufzeichnung gestartet von:
Aufzeichnungsbeginn: 2024-09-10 12:46:45
Aufzeichnungsende: 2024-09-13 9:35:41
Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss): 68:48:55
Anlagen-Typ : Epsilon 2-4 (LSCplus)

Produkt-Nr.: \pdaconservative
Produkt-Name:
Batch-Nr.:
Batch-Name:
Batch-Größe:
Batch Volumen pro Einheit:
Notiz:

- Kanal01: Vak.Pirani
- Kanal02: Stell.Vorl.
- Kanal03: Eiskond.1
- Kanal04: WTMplus #1
- Kanal05: WTMplus #2
- Kanal06: WTMplus #3
- Kanal07: WTMplus #4
- Kanal08: WTMplus #5
- Kanal09: Lyo Rx 1
- Kanal10: Lyo Prod. 1
- Kanal11: unbenutzt
- Kanal12: unbenutzt

Dokument erstellt am: 2024-09-18 09:46:51

LPCplus

Dokument erstellt von:


Unterschrift:

Seite: 1 / 50

Martin Christ GmbH
LSCplus
Prozess-Grafik 24091001.00



Vak.Pirani | Stell.Vorl. | Eiskond.1 | WTMplus #1 | WTMplus #2 | WTMplus #3 | WTMplus #4 | WTMplus #5 | Lyo Rx 1 | Lyo Prod. 1 | unbenutzt | unbenutzt

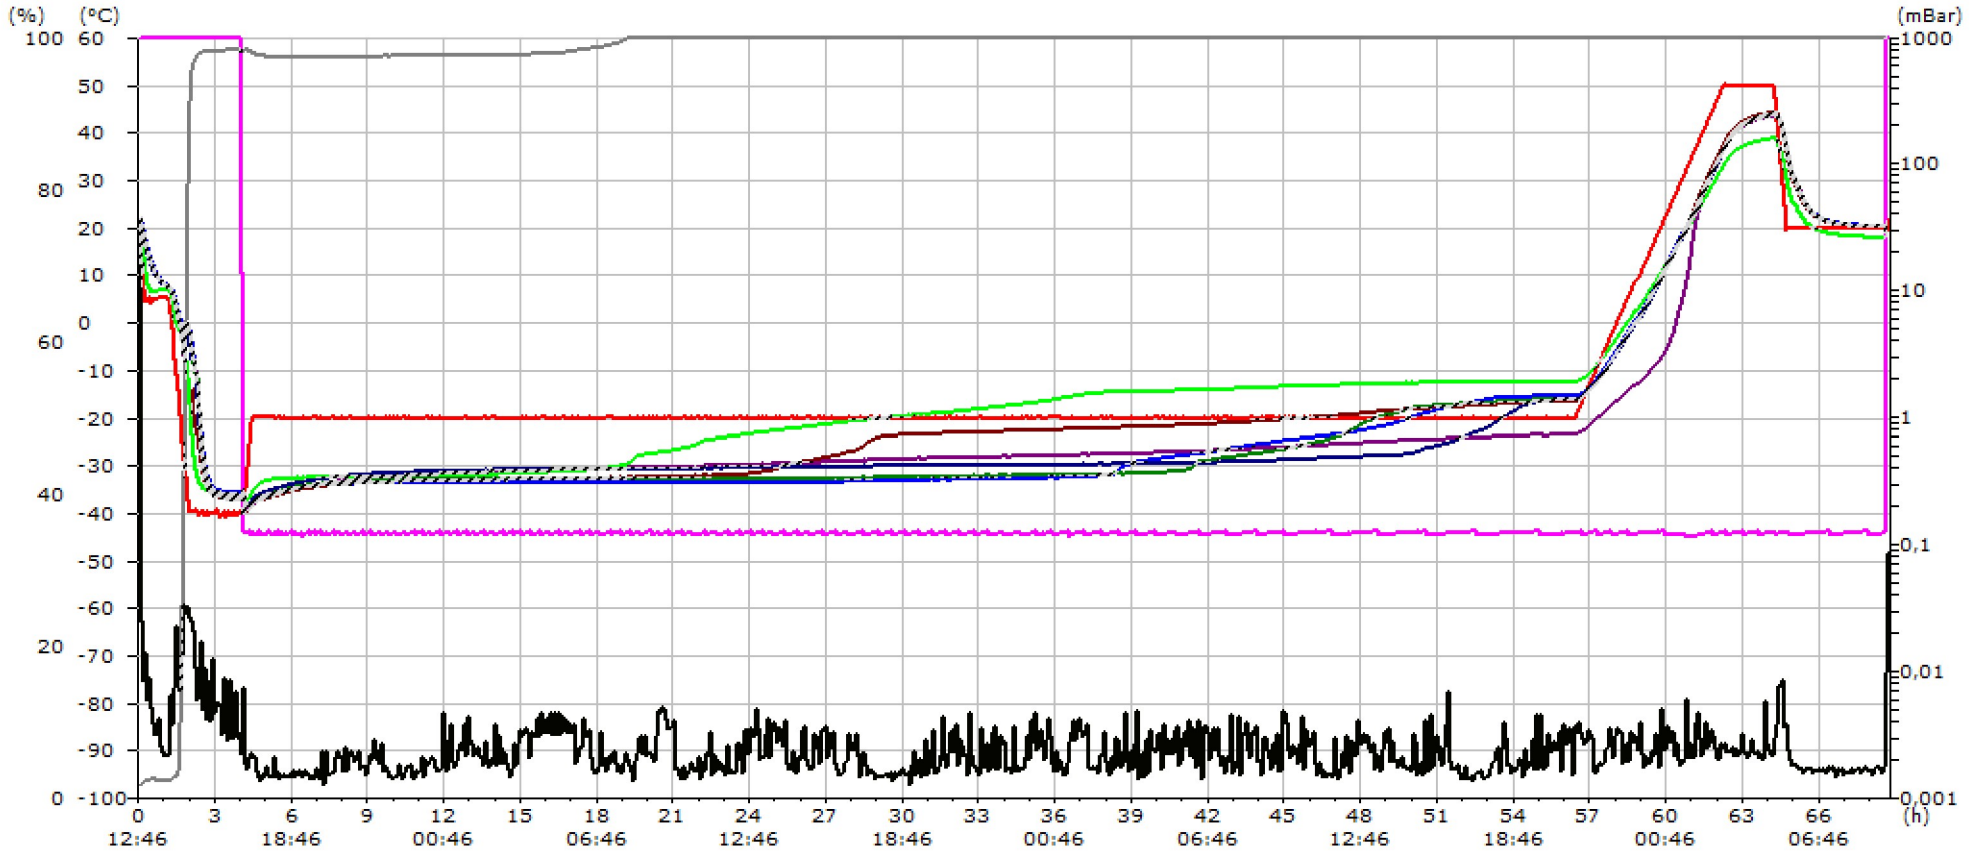

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	2 / 50	

Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00



Datum (jjjmmtt)	Zeit (hh:mm:ss)	Dauer (hhh:mm:ss)	Ereignis	Notiz
2024-09-10	12:46:45	000:00:00	Betriebssystem: 64-bit (6.2.9200)	
2024-09-10	12:46:45	000:00:00	LPCplus Programm-Version: 1.5.32.3 Datum: 04.10.2022	
2024-09-10	12:46:45	000:00:00	Anlagen-Identifikation: LSCplus LSCplus (Programm-Version: 1.5.21.3 11.10.2023)	
2024-09-10	12:46:45	000:00:00	Seriennummer der Anlage: 29984	
2024-09-10	12:46:45	000:00:00	Zugriffsschutz Aus	
2024-09-10	12:46:46	000:00:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskondl WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Prol	
2024-09-10	12:46:46	000:00:01	mBar °C °C °C °C °C °C °C % °C	
2024-09-10	12:46:46	000:00:01	1000 21,7 22,9 22,0 22,1 22,0 22,2 22,2 1,7 21,3	
2024-09-10	12:47:34	000:00:49	Load program, Prg-Nr 8 Abs. 2 Startzeit 0:00 hhh:mm	
2024-09-10	12:47:34	000:00:49	Betriebsart: Standby - Programm - Gefrieren	
2024-09-10	12:47:41	000:00:56	Betriebsart manuell geändert: Run	
2024-09-10	12:47:42	000:00:57		
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	<<< SOLLWERTE TROCKNUNGSPROGRAMM >>>	
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	<<< Programmnummer: 8, Programm-Name: PDA Conservative>>>	
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	Abs. Phase Zeit Stellfl. Vakuum Si.-Druck dT Stell. dT Prod. LyoControl-RX	
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	hhh:mm °C mBar mBar °C °C %	
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	1 Beladen --- 20,0 --- --- --- --- ---	

Aufzeichnungsbeginn: 2024-09-10 12:46:45 Aufzeichnungsende: 2024-09-13 9:35:41 Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):68:48:55

Produkt-Nr.: \pdaconservative Produkt-Name:
 Batch-Nr.: Batch-Name:
 Batch-Größe: Batch Volumen pro Einheit:
 Notiz:

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-10	12:47:42	000:00:57	2 Aus	Gefrieren	0:15	5,0	---	---	Aus	Aus
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	3 Aus	Gefrieren	1:00	5,0	---	---	Aus	Aus
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	4 Aus	Gefrieren	0:45	-40,0	---	---	Aus	Aus
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	5 Aus	Gefrieren	2:00	-40,0	---	---	Aus	Aus
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	6 Aus	Haupttrocknen	0:01	-40,0	0,120	0,260	Aus	Aus
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	7 Aus	Haupttrocknen	0:20	-20,0	0,120	0,260	Aus	Aus
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	8 Aus	Haupttrocknen	52:00	-20,0	0,120	0,260	Aus	Aus
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	9 Aus	Nachtrocknen	5:50	50,0	0,120	0,260	Aus	Aus
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	10 Aus	Nachtrocknen	2:00	50,0	0,120	0,260	Aus	Aus
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	11 Aus	Nachtrocknen	0:30	20,0	0,120	0,260	Aus	Aus
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	<<< Zusätzliche Programm-Regelparameter >>>							
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	Warm Up Vakuumpumpe		15min					
2024-09-10	12:47:42	000:00:57	Betriebsart: Run - Programm - Gefrieren - Prg-Nr 8 - Abs. 2 (0:15 hhh:mm 5,0 °C)							

Aufzeichnungsbeginn: 2024-09-10 12:46:45 Aufzeichnungsende: 2024-09-13 9:35:41 Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):68:48:55
 Produkt-Nr.: \pdaconservative Produkt-Name:
 Batch-Nr.: Batch-Name:
 Batch-Größe: Batch Volumen pro Einheit:
 Notiz:
 Dokument erstellt am: 2024-09-18 09:46:51 LPCplus
 Dokument erstellt von: Unterschrift: Seite: 4 / 50

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-10	12:51:45	000:05:00	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Pro1									
2024-09-10	12:51:45	000:05:00	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-10	12:51:45	000:05:00	1000	21,3	20,6	22,0	22,1	---	22,1	22,1	1,7	21,3
2024-09-10	12:56:45	000:10:00	1000	9,0	-65,3	20,6	20,9	---	20,6	20,2	1,9	17,2
2024-09-10	13:01:45	000:15:00	1000	6,4	-64,8	18,5	19,0	18,4	18,5	17,9	2,1	13,0
2024-09-10	13:02:42	000:15:57	Betriebsart: Run - Programm - Gefrieren - Prg-Nr 8 - Abs. 3 (1:00 hhh:mm 5,0 °C)									
2024-09-10	13:06:45	000:20:00	1000	5,0	-79,6	16,1	16,8	---	16,2	15,6	2,3	9,4
2024-09-10	13:11:45	000:25:00	1000	4,1	-75,7	14,4	15,1	---	14,5	13,9	2,4	7,7
2024-09-10	13:16:45	000:30:00	1000	5,2	-82,6	13,0	13,6	---	13,1	12,6	2,4	6,8
2024-09-10	13:21:45	000:35:00	1000	5,2	-76,8	11,9	12,4	---	12,0	11,5	2,4	6,5
2024-09-10	13:26:45	000:40:00	1000	4,8	-84,2	10,9	11,4	---	11,0	10,6	2,4	6,4
2024-09-10	13:31:45	000:45:00	1000	5,1	-85,8	10,0	10,5	---	10,2	9,8	2,4	6,6
2024-09-10	13:36:45	000:50:00	1000	5,4	-88,4	9,3	9,7	---	9,5	9,2	2,4	6,8
2024-09-10	13:41:45	000:55:00	1000	5,2	-88,9	8,8	9,1	---	8,9	8,7	2,4	6,8
2024-09-10	13:46:45	001:00:00	1000	5,3	-89,8	8,3	8,6	---	8,4	8,3	2,4	6,9
2024-09-10	13:51:45	001:05:00	1000	5,3	-90,9	8,0	8,2	---	8,1	8,0	2,4	6,9
2024-09-10	13:56:45	001:10:00	1000	5,2	-91,1	7,6	7,9	---	7,8	7,7	2,4	6,9
2024-09-10	14:01:45	001:15:00	1000	5,1	-91,1	7,4	7,6	---	7,5	7,4	2,4	6,8
2024-09-10	14:02:41	001:15:56	Betriebsart: Run - Programm - Gefrieren - Prg-Nr 8 - Abs. 4 (0:45 hhh:mm -40,0 °C)									
2024-09-10	14:06:45	001:20:00	1000	1,8	-81,0	7,0	7,2	---	7,1	6,9	2,4	5,7
2024-09-10	14:11:45	001:25:00	1000	-4,0	-81,6	5,9	6,3	---	6,0	5,6	2,8	2,2

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	5 / 50	

Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00



2024-09-10	14:16:45	001:30:00	1000	-9,8	-77,0	4,2	4,8	---	4,3	3,7	2,9	0,1	
2024-09-10	14:21:45	001:35:00	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Pro1										
2024-09-10	14:21:45	001:35:00	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C	
2024-09-10	14:21:45	001:35:00	1000	-14,9	-72,5	1,9	2,8	---	2,2	1,3	3,1	-0,4	
2024-09-10	14:26:45	001:40:00	1000	-19,9	-68,8	0,3	1,4	---	0,8	-0,8	7,5	-1,2	
2024-09-10	14:31:45	001:45:00	1000	-24,4	-64,3	-3,1	-2,5	---	-3,4	-2,3	23,3	-3,2	
2024-09-10	14:36:45	001:50:00	1000	-28,7	-59,3	-5,6	-6,4	---	-7,0	-0,5	43,2	-5,6	
2024-09-10	14:37:30	001:50:45	Beginn Alarm: OFFLINE (4): Keine Kommunikation zwischen LPCplus und LSCplus										
2024-09-10	14:37:33	001:50:48	Ende Alarm: OFFLINE (2): Keine Kommunikation zwischen LPCplus und LSCplus										
2024-09-10	14:37:33	001:50:48	Betriebssystem: 64-bit (6.2.9200)										
2024-09-10	14:37:33	001:50:48	LPCplus Programm-Version: 1.5.32.3 Datum: 04.10.2022										
2024-09-10	14:37:33	001:50:48	Anlagen-Identifikation: LSCplus LSCplus (Programm-Version: 1.5.21.3 11.10.2023)										
2024-09-10	14:37:33	001:50:48	Seriennummer der Anlage: 29984										
2024-09-10	14:37:33	001:50:48	Zugriffsschutz				Aus						
2024-09-10	14:41:48	001:55:03	1000	-33,6	-57,7	-0,5	-0,2	---	-0,4	-0,7	65,6	-8,6	
2024-09-10	14:46:47	002:00:02	1000	-38,8	-63,1	-0,9	-0,3	---	-0,6	-2,3	83,9	-12,8	
2024-09-10	14:47:43	002:00:58	Betriebsart: Run - Programm - Gefrieren - Prg-Nr 8 - Abs. 5 (2:00 hhh:mm -40,0 °C)										
2024-09-10	14:51:49	002:05:04	1000	-39,3	-76,3	---	-2,1	---	-2,8	-5,7	93,4	-18,9	
2024-09-10	14:56:47	002:10:02	1000	-39,2	-73,4	-7,0	-5,2	---	-6,1	-8,3	96,3	-25,3	
2024-09-10	15:01:47	002:15:02	1000	-39,2	-70,0	-9,4	-7,9	-20,7	-8,8	-10,3	97,1	-29,3	
2024-09-10	15:06:47	002:20:02	1000	-39,1	-73,0	-11,4	-9,7	-22,6	-11,0	-13,1	97,6	-31,7	

Aufzeichnungsbeginn: 2024-09-10 12:46:45 Aufzeichnungsende: 2024-09-13 9:35:41 Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):68:48:55
 Produkt-Nr.: \pdaconservative Produkt-Name:
 Batch-Nr.: Batch-Name:
 Batch-Größe: Batch Volumen pro Einheit:
 Notiz:
 Dokument erstellt am: 2024-09-18 09:46:51 LPCplus
 Dokument erstellt von: Unterschrift: Seite: 6 / 50

Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00



2024-09-10	15:11:47	002:25:02	1000	-39,3	-79,4	---	---	-25,1	-16,1	-20,2	97,8	-33,1	
2024-09-10	15:16:47	002:30:02	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1	
2024-09-10	15:16:47	002:30:02	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C	
2024-09-10	15:16:47	002:30:02	1000	-39,8	-80,6	-22,6	---	-28,3	-23,5	-26,3	98,0	-34,1	
2024-09-10	15:21:47	002:35:02	1000	-40,5	-77,5	-27,2	-26,5	-31,1	-28,1	-30,1	98,1	-34,7	
2024-09-10	15:26:47	002:40:02	1000	-39,9	-67,9	-30,3	-29,8	-33,0	-30,9	-32,5	98,1	-34,7	
2024-09-10	15:31:47	002:45:02	1000	-39,6	-83,5	-32,3	-31,8	-34,3	-32,5	-34,0	98,2	-35,0	
2024-09-10	15:36:47	002:50:02	1000	-40,6	-79,8	-33,6	-33,1	-35,1	-33,7	-34,9	98,3	-35,5	
2024-09-10	15:41:47	002:55:02	1000	-39,4	-76,0	-34,4	-33,9	-35,7	-34,6	-35,6	98,2	-35,2	
2024-09-10	15:46:47	003:00:02	1000	-40,3	-82,2	-35,0	-34,5	-36,1	-35,2	-36,0	98,3	-35,8	
2024-09-10	15:51:47	003:05:02	1000	-39,9	-70,7	-35,4	-34,9	-36,4	-35,6	-36,3	98,3	-35,5	
2024-09-10	15:56:47	003:10:02	1000	-40,0	-85,2	-35,6	-35,2	-36,7	-35,9	-36,6	98,3	-36,0	
2024-09-10	16:01:47	003:15:02	1000	-39,8	-73,2	-35,8	-35,3	-36,7	-36,0	-36,7	98,3	-35,8	
2024-09-10	16:06:47	003:20:02	1000	-40,2	-85,0	-35,9	-35,5	-36,9	-36,2	-36,9	98,4	-36,3	
2024-09-10	16:11:47	003:25:02	1000	-39,7	-74,2	-36,0	-35,5	-36,9	-36,2	-36,9	98,3	-36,0	
2024-09-10	16:16:47	003:30:02	1000	-40,3	-85,4	-36,1	-35,6	-37,0	-36,3	-37,0	98,4	-36,5	
2024-09-10	16:21:47	003:35:02	1000	-39,5	-78,1	-36,1	-35,6	-37,0	-36,4	-37,0	98,3	-36,1	
2024-09-10	16:26:47	003:40:02	1000	-40,5	-85,4	-36,2	-35,7	-37,1	-36,4	-37,1	98,4	-36,6	
2024-09-10	16:31:47	003:45:02	1000	-39,4	-82,5	-36,2	-35,8	-37,1	-36,4	-37,1	98,3	-36,2	
2024-09-10	16:32:41	003:45:56	Betriebsart: Run - Programm - Gefrieren - Warm Up										
2024-09-10	16:36:47	003:50:02	1000	-40,7	-85,1	-36,2	-35,7	-37,0	-36,4	-37,1	98,4	-36,7	

Aufzeichnungsbeginn: 2024-09-10 12:46:45 Aufzeichnungsende: 2024-09-13 9:35:41 Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):68:48:55
 Produkt-Nr.: \pdaconservative Produkt-Name:
 Batch-Nr.: Batch-Name:
 Batch-Größe: Batch Volumen pro Einheit:
 Notiz:
 Dokument erstellt am: 2024-09-18 09:46:51 LPCplus
 Dokument erstellt von: Unterschrift: Seite: 7 / 50

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-10	16:41:47	003:55:02	1000	-39,5	-86,8	-36,2	-35,8	-37,1	-36,4	-37,1	98,4	-36,3
2024-09-10	16:46:47	004:00:02	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Pro1									
2024-09-10	16:46:47	004:00:02	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-10	16:46:47	004:00:02	1000	-41,0	-83,5	-36,2	-35,7	-37,0	-36,4	-37,0	98,4	-36,8
2024-09-10	16:47:41	004:00:56	Betriebsart: Run - Programm - Haupttrocknen - Prg-Nr 8 - Abs. 6 (0:01 hhh:mm -40,0 °C 0,120 mBar)									
2024-09-10	16:51:47	004:05:02	0,386	-38,3	-92,7	-36,0	-35,6	-36,7	-36,1	-36,7	98,3	-36,3
2024-09-10	16:53:21	004:06:36	Betriebsart: Run - Programm - Haupttrocknen - Prg-Nr 8 - Abs. 7 (0:20 hhh:mm -20,0 °C 0,120 mBar)									
2024-09-10	16:56:47	004:10:02	0,125	-37,2	-89,6	-37,3	-37,0	-38,5	-37,7	-37,4	98,4	-37,5
2024-09-10	17:01:47	004:15:02	0,121	-31,8	-93,4	-38,4	-38,2	-39,4	-39,1	-38,2	98,4	-37,4
2024-09-10	17:06:47	004:20:02	0,127	-26,9	-92,5	-38,6	-38,4	-39,3	-39,2	-38,2	98,3	-37,0
2024-09-10	17:11:47	004:25:02	0,125	-21,8	-91,4	-38,2	-38,1	-38,8	-38,8	-37,7	98,2	-36,1
2024-09-10	17:13:21	004:26:36	Betriebsart: Run - Programm - Haupttrocknen - Prg-Nr 8 - Abs. 8 (52:00 hhh:mm -20,0 °C 0,120 mBar)									
2024-09-10	17:16:46	004:30:01	0,122	-19,7	-91,8	-37,6	-37,5	-38,1	-38,2	-37,0	98,1	-35,2
2024-09-10	17:21:46	004:35:01	0,121	-19,9	-91,6	-37,2	-37,0	-37,8	-37,8	-36,6	97,9	-34,7
2024-09-10	17:26:46	004:40:01	0,122	-19,6	-93,8	-36,9	-36,8	-37,5	-37,6	-36,3	97,8	-34,2
2024-09-10	17:31:46	004:45:01	0,119	-19,8	-95,8	-36,7	-36,6	-37,4	-37,4	-36,0	97,7	-33,8
2024-09-10	17:36:46	004:50:01	0,122	-19,9	-95,8	-36,6	-36,5	-37,3	-37,2	-35,8	97,7	-33,5
2024-09-10	17:41:46	004:55:01	0,123	-20,0	-96,2	-36,4	-36,4	-37,2	-37,1	-35,7	97,6	-33,3
2024-09-10	17:46:46	005:00:01	0,123	-20,0	-96,2	-36,3	-36,3	-37,0	-36,9	-35,6	97,6	-33,2

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	8 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-10	17:51:46	005:05:01	0,123	-20,0	-95,7	-36,2	-36,2	-36,9	-36,8	-35,4	97,6	-33,1
2024-09-10	17:56:46	005:10:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-10	17:56:46	005:10:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-10	17:56:46	005:10:01	0,120	-20,0	-96,2	-36,0	-36,0	-36,8	-36,6	-35,3	97,6	-33,0
2024-09-10	18:01:46	005:15:01	0,117	-20,0	-96,2	-35,9	-35,9	-36,6	-36,5	-35,1	97,5	-32,9
2024-09-10	18:06:46	005:20:01	0,125	-20,0	-93,8	-35,8	-35,8	-36,5	-36,4	-35,0	97,5	-32,9
2024-09-10	18:11:46	005:25:01	0,119	-20,0	-95,9	-35,6	-35,7	-36,4	-36,2	-34,9	97,5	-32,9
2024-09-10	18:16:46	005:30:01	0,126	-20,0	-94,8	-35,5	-35,6	-36,2	-36,0	-34,7	97,5	-32,8
2024-09-10	18:21:46	005:35:01	0,120	-20,0	-95,4	-35,4	-35,5	-36,1	-35,9	-34,6	97,5	-32,8
2024-09-10	18:26:46	005:40:01	0,125	-20,0	-95,9	-35,2	-35,4	-35,9	-35,7	-34,4	97,5	-32,7
2024-09-10	18:31:46	005:45:01	0,120	-20,0	-94,9	-35,1	-35,3	-35,8	-35,6	-34,3	97,5	-32,7
2024-09-10	18:36:46	005:50:01	0,126	-20,0	-95,0	-35,0	-35,2	-35,7	-35,5	-34,2	97,5	-32,7
2024-09-10	18:41:46	005:55:01	0,120	-20,0	-95,0	-34,9	-35,1	-35,6	-35,3	-34,1	97,5	-32,7
2024-09-10	18:46:46	006:00:01	0,124	-20,0	-94,9	-34,7	-35,0	-35,5	-35,2	-34,0	97,5	-32,6
2024-09-10	18:51:46	006:05:01	0,118	-20,0	-91,3	-34,6	-34,9	-35,3	-35,1	-33,9	97,5	-32,6
2024-09-10	18:56:46	006:10:01	0,122	-20,0	-95,7	-34,6	-34,8	-35,3	-35,0	-33,8	97,5	-32,6
2024-09-10	19:01:46	006:15:01	0,126	-20,0	-94,9	-34,5	-34,7	-35,1	-34,8	-33,6	97,5	-32,6
2024-09-10	19:06:46	006:20:01	0,120	-20,0	-93,8	-34,4	-34,7	-35,1	-34,7	-33,6	97,5	-32,6
2024-09-10	19:11:46	006:25:01	0,123	-20,0	-95,1	-34,3	-34,6	-35,0	-34,6	-33,5	97,5	-32,6
2024-09-10	19:16:46	006:30:01	0,117	-20,0	-95,3	-34,2	-34,5	-34,8	-34,5	-33,4	97,5	-32,5
2024-09-10	19:21:46	006:35:01	0,121	-20,0	-96,0	-34,2	-34,5	-34,9	-34,5	-33,3	97,5	-32,5

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	9 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-10	19:26:46	006:40:01	0,125	-20,0	-95,5	-34,1	-34,5	-34,7	-34,4	-33,2	97,5	-32,5
2024-09-10	19:31:46	006:45:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-10	19:31:46	006:45:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-10	19:31:46	006:45:01	0,117	-20,0	-96,0	-34,0	-34,3	-34,6	-34,2	-33,1	97,5	-32,5
2024-09-10	19:36:46	006:50:01	0,120	-20,0	-96,3	-34,0	-34,3	-34,6	-34,2	-33,1	97,5	-32,5
2024-09-10	19:41:46	006:55:01	0,124	-20,0	-95,1	-33,9	-34,3	-34,5	-34,1	-33,0	97,5	-32,5
2024-09-10	19:46:46	007:00:01	0,118	-20,0	-95,8	-33,9	-34,2	-34,5	-34,0	-32,9	97,5	-32,5
2024-09-10	19:51:46	007:05:01	0,121	-20,0	-95,9	-33,9	-34,2	-34,5	-34,0	-32,9	97,5	-32,5
2024-09-10	19:56:46	007:10:01	0,124	-20,0	-95,2	-33,8	-34,2	-34,4	-33,9	-32,8	97,5	-32,4
2024-09-10	20:01:46	007:15:01	0,118	-20,0	-93,0	-33,7	-34,1	-34,3	-33,8	-32,7	97,5	-32,4
2024-09-10	20:06:46	007:20:01	0,121	-20,0	-97,0	-33,7	-34,1	-34,3	-33,7	-32,7	97,5	-32,4
2024-09-10	20:11:46	007:25:01	0,125	-20,0	-92,7	-33,7	-34,1	-34,2	-33,7	-32,6	97,5	-32,4
2024-09-10	20:16:46	007:30:01	0,119	-20,0	-95,0	-33,6	-34,0	-34,1	-33,6	-32,6	97,5	-32,4
2024-09-10	20:21:46	007:35:01	0,121	-20,0	-89,0	-33,6	-34,0	-34,1	-33,5	-32,5	97,5	-32,4
2024-09-10	20:26:46	007:40:01	0,125	-20,0	-91,5	-33,5	-34,0	-34,1	-33,5	-32,5	97,5	-32,4
2024-09-10	20:31:46	007:45:01	0,118	-20,0	-94,8	-33,5	-33,9	-34,0	-33,4	-32,4	97,5	-32,4
2024-09-10	20:36:46	007:50:01	0,120	-20,0	-95,5	-33,5	-33,9	-34,0	-33,4	-32,4	97,6	-32,4
2024-09-10	20:41:46	007:55:01	0,123	-20,0	-92,0	-33,4	-33,9	-34,0	-33,3	-32,3	97,6	-32,4
2024-09-10	20:46:46	008:00:01	0,126	-20,0	-89,5	-33,4	-33,8	-33,9	-33,2	-32,3	97,5	-32,3
2024-09-10	20:51:46	008:05:01	0,119	-20,0	-94,0	-33,4	-33,9	-33,9	-33,2	-32,2	97,6	-32,4
2024-09-10	20:56:46	008:10:01	0,121	-20,0	-87,8	-33,4	-33,9	-33,9	-33,2	-32,2	97,6	-32,4

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	10 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-10	21:01:46	008:15:01	0,125	-20,0	-94,3	-33,3	-33,8	-33,8	-33,1	-32,2	97,6	-32,3
2024-09-10	21:06:46	008:20:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-10	21:06:46	008:20:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-10	21:06:46	008:20:01	0,117	-20,0	-87,1	-33,2	-33,8	-33,7	-33,0	-32,1	97,6	-32,3
2024-09-10	21:11:46	008:25:01	0,120	-20,0	-92,9	-33,3	-33,8	-33,8	-33,0	-32,1	97,6	-32,3
2024-09-10	21:16:46	008:30:01	0,123	-20,0	-91,0	-33,3	-33,8	-33,7	-33,0	-32,0	97,6	-32,3
2024-09-10	21:21:46	008:35:01	0,126	-20,0	-90,0	-33,2	-33,7	-33,7	-32,9	-32,0	97,6	-32,3
2024-09-10	21:26:46	008:40:01	0,118	-20,0	-90,9	-33,2	-33,7	-33,7	-32,9	-32,0	97,6	-32,3
2024-09-10	21:31:46	008:45:01	0,121	-20,0	-92,6	-33,2	-33,7	-33,7	-32,8	-31,9	97,6	-32,3
2024-09-10	21:36:46	008:50:01	0,125	-20,0	-92,8	-33,2	-33,7	-33,6	-32,8	-31,9	97,6	-32,3
2024-09-10	21:41:46	008:55:01	0,118	-20,0	-90,0	-33,1	-33,7	-33,5	-32,7	-31,8	97,6	-32,2
2024-09-10	21:46:46	009:00:01	0,119	-20,0	-93,4	-33,1	-33,7	-33,6	-32,7	-31,8	97,6	-32,3
2024-09-10	21:51:46	009:05:01	0,122	-20,0	-90,2	-33,1	-33,7	-33,6	-32,7	-31,8	97,6	-32,3
2024-09-10	21:56:46	009:10:01	0,126	-20,0	-91,3	-33,1	-33,6	-33,5	-32,6	-31,8	97,6	-32,2
2024-09-10	22:01:46	009:15:01	0,119	-20,0	-89,2	-33,1	-33,6	-33,5	-32,6	-31,7	97,6	-32,2
2024-09-10	22:06:46	009:20:01	0,122	-20,0	-92,6	-33,1	-33,7	-33,5	-32,6	-31,7	97,6	-32,3
2024-09-10	22:11:46	009:25:01	0,123	-20,0	-90,5	-33,1	-33,6	-33,5	-32,5	-31,7	97,6	-32,2
2024-09-10	22:16:46	009:30:01	0,126	-20,0	-89,7	-33,0	-33,6	-33,4	-32,5	-31,6	97,6	-32,2
2024-09-10	22:21:46	009:35:01	0,119	-20,0	-93,6	-33,0	-33,6	-33,5	-32,4	-31,6	97,6	-32,2
2024-09-10	22:26:46	009:40:01	0,121	-20,0	-92,3	-33,0	-33,6	-33,5	-32,4	-31,6	97,6	-32,2
2024-09-10	22:31:46	009:45:01	0,123	-20,0	-94,7	-33,0	-33,6	-33,4	-32,4	-31,6	97,6	-32,2

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	11 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-10	22:36:46	009:50:01	0,126	-20,0	-94,7	-33,0	-33,6	-33,4	-32,3	-31,5	97,6	-32,1
2024-09-10	22:41:46	009:55:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-10	22:41:46	009:55:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-10	22:41:46	009:55:01	0,120	-20,0	-95,5	-33,0	-33,6	-33,4	-32,3	-31,5	97,6	-32,2
2024-09-10	22:46:46	010:00:01	0,121	-20,0	-95,4	-33,0	-33,6	-33,4	-32,3	-31,5	97,6	-32,2
2024-09-10	22:51:46	010:05:01	0,124	-20,0	-95,7	-33,0	-33,6	-33,4	-32,3	-31,5	97,6	-32,2
2024-09-10	22:56:46	010:10:01	0,117	-20,0	-94,2	-32,9	-33,5	-33,3	-32,2	-31,5	97,6	-32,1
2024-09-10	23:01:46	010:15:01	0,119	-20,0	-91,0	-33,0	-33,6	-33,4	-32,2	-31,5	97,6	-32,2
2024-09-10	23:06:46	010:20:01	0,121	-20,0	-96,2	-33,0	-33,6	-33,4	-32,2	-31,5	97,6	-32,2
2024-09-10	23:11:46	010:25:01	0,124	-20,0	-93,1	-33,0	-33,6	-33,3	-32,2	-31,4	97,6	-32,2
2024-09-10	23:16:46	010:30:01	0,127	-20,0	-95,8	-32,9	-33,5	-33,2	-32,1	-31,4	97,6	-32,1
2024-09-10	23:21:46	010:35:01	0,118	-20,0	-92,7	-33,0	-33,6	-33,3	-32,1	-31,4	97,6	-32,2
2024-09-10	23:26:46	010:40:01	0,121	-20,0	-92,5	-33,0	-33,6	-33,3	-32,1	-31,4	97,6	-32,2
2024-09-10	23:31:46	010:45:01	0,123	-20,0	-95,2	-32,9	-33,6	-33,3	-32,1	-31,4	97,6	-32,2
2024-09-10	23:36:46	010:50:01	0,126	-20,0	-93,8	-32,9	-33,5	-33,2	-32,0	-31,3	97,6	-32,1
2024-09-10	23:41:46	010:55:01	0,118	-20,0	-95,1	-32,9	-33,5	-33,3	-32,0	-31,3	97,6	-32,1
2024-09-10	23:46:46	011:00:01	0,121	-20,0	-94,5	-32,9	-33,6	-33,3	-32,0	-31,3	97,7	-32,2
2024-09-10	23:51:46	011:05:01	0,124	-20,0	-94,7	-32,9	-33,5	-33,2	-32,0	-31,3	97,7	-32,1
2024-09-10	23:56:46	011:10:01	0,127	-20,0	-94,1	-32,9	-33,5	-33,2	-31,9	-31,3	97,6	-32,1
2024-09-11	00:01:46	011:15:01	0,119	-20,0	-93,2	-32,9	-33,5	-33,2	-31,9	-31,3	97,7	-32,1
2024-09-11	00:06:46	011:20:01	0,121	-20,0	-94,9	-32,9	-33,5	-33,2	-31,9	-31,3	97,7	-32,1

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	12 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-11	00:11:46	011:25:01	0,124	-20,0	-93,4	-32,9	-33,5	-33,2	-31,9	-31,2	97,7	-32,1
2024-09-11	00:16:46	011:30:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-11	00:16:46	011:30:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-11	00:16:46	011:30:01	0,127	-20,0	-93,2	-32,8	-33,5	-33,1	-31,8	-31,2	97,7	-32,0
2024-09-11	00:21:46	011:35:01	0,119	-20,0	-91,0	-32,9	-33,5	-33,2	-31,8	-31,2	97,7	-32,1
2024-09-11	00:26:46	011:40:01	0,122	-20,0	-93,5	-32,9	-33,5	-33,2	-31,8	-31,2	97,7	-32,1
2024-09-11	00:31:46	011:45:01	0,123	-20,0	-95,2	-32,9	-33,5	-33,2	-31,8	-31,2	97,7	-32,1
2024-09-11	00:36:46	011:50:01	0,126	-20,0	-94,0	-32,8	-33,5	-33,1	-31,7	-31,2	97,7	-32,0
2024-09-11	00:41:46	011:55:01	0,118	-20,0	-94,1	-32,8	-33,5	-33,1	-31,7	-31,2	97,7	-32,1
2024-09-11	00:46:46	012:00:01	0,120	-20,0	-89,9	-32,9	-33,5	-33,2	-31,7	-31,2	97,7	-32,1
2024-09-11	00:51:46	012:05:01	0,123	-20,0	-94,3	-32,9	-33,5	-33,1	-31,7	-31,2	97,7	-32,0
2024-09-11	00:56:46	012:10:01	0,125	-20,0	-92,3	-32,8	-33,5	-33,1	-31,7	-31,1	97,7	-32,0
2024-09-11	01:01:46	012:15:01	0,119	-20,0	-93,9	-32,8	-33,5	-33,1	-31,6	-31,1	97,7	-32,0
2024-09-11	01:06:46	012:20:01	0,120	-20,0	-91,4	-32,9	-33,5	-33,1	-31,7	-31,1	97,7	-32,0
2024-09-11	01:11:46	012:25:01	0,122	-20,0	-90,9	-32,9	-33,5	-33,1	-31,6	-31,1	97,7	-32,0
2024-09-11	01:16:46	012:30:01	0,124	-20,0	-91,3	-32,8	-33,5	-33,1	-31,6	-31,1	97,7	-32,0
2024-09-11	01:21:46	012:35:01	0,119	-20,0	-91,2	-32,8	-33,4	-33,0	-31,6	-31,0	97,7	-31,9
2024-09-11	01:26:46	012:40:01	0,120	-20,0	-87,0	-32,9	-33,5	-33,1	-31,6	-31,1	97,7	-32,0
2024-09-11	01:31:46	012:45:01	0,122	-20,0	-85,9	-32,9	-33,5	-33,1	-31,6	-31,1	97,7	-32,0
2024-09-11	01:36:46	012:50:01	0,125	-20,0	-85,8	-32,8	-33,5	-33,0	-31,5	-31,0	97,7	-31,9
2024-09-11	01:41:46	012:55:01	0,122	-20,0	-87,3	-32,8	-33,4	-33,0	-31,5	-31,0	97,7	-31,9

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	13 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-11	01:46:46	013:00:01	0,120	-20,0	-86,9	-32,8	-33,5	-33,1	-31,5	-31,0	97,7	-31,9
2024-09-11	01:51:46	013:05:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-11	01:51:46	013:05:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-11	01:51:46	013:05:01	0,121	-20,0	-92,0	-32,9	-33,5	-33,1	-31,5	-31,0	97,7	-31,9
2024-09-11	01:56:46	013:10:01	0,124	-20,0	-92,5	-32,8	-33,5	-33,0	-31,5	-31,0	97,7	-31,9
2024-09-11	02:01:46	013:15:01	0,126	-20,0	-93,9	-32,8	-33,5	-33,0	-31,4	-31,0	97,7	-31,8
2024-09-11	02:06:46	013:20:01	0,119	-20,0	-92,8	-32,8	-33,5	-33,0	-31,4	-31,0	97,7	-31,9
2024-09-11	02:11:46	013:25:01	0,122	-20,0	-88,7	-32,9	-33,5	-33,0	-31,4	-31,0	97,8	-31,9
2024-09-11	02:16:46	013:30:01	0,123	-20,0	-88,9	-32,8	-33,5	-33,0	-31,4	-31,0	97,8	-31,8
2024-09-11	02:21:46	013:35:01	0,125	-20,0	-91,5	-32,8	-33,5	-33,0	-31,4	-31,0	97,8	-31,8
2024-09-11	02:26:46	013:40:01	0,118	-20,0	-91,2	-32,8	-33,5	-33,0	-31,3	-30,9	97,8	-31,8
2024-09-11	02:31:46	013:45:01	0,121	-20,0	-92,4	-32,8	-33,5	-33,0	-31,3	-31,0	97,8	-31,8
2024-09-11	02:36:46	013:50:01	0,122	-20,0	-96,0	-32,8	-33,5	-33,0	-31,3	-31,0	97,8	-31,8
2024-09-11	02:41:46	013:55:01	0,125	-20,0	-93,9	-32,8	-33,5	-33,0	-31,3	-30,9	97,8	-31,8
2024-09-11	02:46:46	014:00:01	0,127	-20,0	-89,0	-32,8	-33,4	-32,9	-31,3	-30,9	97,8	-31,7
2024-09-11	02:51:46	014:05:01	0,119	-20,0	-91,5	-32,8	-33,5	-33,0	-31,3	-30,9	97,8	-31,8
2024-09-11	02:56:46	014:10:01	0,121	-20,0	-93,1	-32,8	-33,5	-33,0	-31,3	-30,9	97,8	-31,8
2024-09-11	03:01:46	014:15:01	0,123	-20,0	-89,8	-32,8	-33,5	-33,0	-31,3	-30,9	97,8	-31,7
2024-09-11	03:06:46	014:20:01	0,126	-20,0	-94,2	-32,8	-33,5	-32,9	-31,2	-30,9	97,8	-31,7
2024-09-11	03:11:46	014:25:01	0,119	-20,0	-88,8	-32,8	-33,5	-32,9	-31,2	-30,9	97,8	-31,7
2024-09-11	03:16:46	014:30:01	0,120	-20,0	-94,7	-32,8	-33,5	-33,0	-31,2	-30,9	97,8	-31,8

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	14 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-11	03:21:46	014:35:01	0,123	-20,0	-94,5	-32,8	-33,5	-32,9	-31,2	-30,9	97,8	-31,7
2024-09-11	03:26:46	014:40:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-11	03:26:46	014:40:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-11	03:26:46	014:40:01	0,124	-20,0	-95,4	-32,8	-33,5	-32,9	-31,2	-30,9	97,8	-31,7
2024-09-11	03:31:46	014:45:01	0,117	-20,0	-95,6	-32,8	-33,4	-32,8	-31,1	-30,8	97,8	-31,6
2024-09-11	03:36:46	014:50:01	0,120	-20,0	-85,3	-32,8	-33,5	-32,9	-31,1	-30,9	97,8	-31,7
2024-09-11	03:41:46	014:55:01	0,122	-20,0	-94,7	-32,8	-33,5	-32,9	-31,2	-30,9	97,8	-31,7
2024-09-11	03:46:46	015:00:01	0,124	-20,0	-92,1	-32,8	-33,5	-32,9	-31,1	-30,8	97,8	-31,6
2024-09-11	03:51:46	015:05:01	0,126	-20,0	-92,1	-32,8	-33,4	-32,8	-31,1	-30,8	97,8	-31,5
2024-09-11	03:56:46	015:10:01	0,119	-20,0	-92,4	-32,8	-33,5	-32,9	-31,1	-30,8	97,8	-31,6
2024-09-11	04:01:46	015:15:01	0,122	-20,0	-83,3	-32,8	-33,5	-32,9	-31,1	-30,8	97,8	-31,6
2024-09-11	04:06:46	015:20:01	0,124	-20,0	-90,2	-32,8	-33,5	-32,9	-31,1	-30,8	97,8	-31,5
2024-09-11	04:11:46	015:25:01	0,126	-20,0	-91,1	-32,8	-33,5	-32,8	-31,0	-30,8	97,8	-31,5
2024-09-11	04:16:46	015:30:01	0,119	-20,0	-88,3	-32,8	-33,5	-32,9	-31,0	-30,8	97,8	-31,5
2024-09-11	04:21:46	015:35:01	0,120	-20,0	-87,2	-32,9	-33,5	-32,9	-31,0	-30,8	97,9	-31,5
2024-09-11	04:26:46	015:40:01	0,123	-20,0	-86,0	-32,8	-33,5	-32,9	-31,0	-30,8	97,9	-31,5
2024-09-11	04:31:46	015:45:01	0,125	-20,0	-85,9	-32,8	-33,5	-32,8	-31,0	-30,8	97,9	-31,4
2024-09-11	04:36:46	015:50:01	0,118	-20,0	-85,2	-32,8	-33,5	-32,8	-31,0	-30,8	97,9	-31,4
2024-09-11	04:41:46	015:55:01	0,120	-20,0	-82,1	-32,9	-33,5	-32,9	-31,0	-30,8	97,9	-31,4
2024-09-11	04:46:46	016:00:01	0,122	-20,0	-82,3	-32,9	-33,5	-32,9	-31,0	-30,8	97,9	-31,4
2024-09-11	04:51:46	016:05:01	0,124	-20,0	-83,2	-32,9	-33,5	-32,8	-31,0	-30,8	97,9	-31,3

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	15 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-11	04:56:46	016:10:01	0,126	-20,0	-84,5	-32,8	-33,5	-32,8	-30,9	-30,8	97,9	-31,3
2024-09-11	05:01:46	016:15:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-11	05:01:46	016:15:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-11	05:01:46	016:15:01	0,120	-20,0	-85,9	-32,9	-33,5	-32,8	-30,9	-30,8	98,0	-31,3
2024-09-11	05:06:46	016:20:01	0,121	-20,0	-86,3	-32,9	-33,6	-32,8	-30,9	-30,8	98,0	-31,3
2024-09-11	05:11:46	016:25:01	0,123	-20,0	-86,6	-32,9	-33,5	-32,8	-30,9	-30,8	98,0	-31,3
2024-09-11	05:16:46	016:30:01	0,126	-20,0	-81,7	-32,8	-33,5	-32,8	-30,9	-30,8	98,0	-31,2
2024-09-11	05:21:46	016:35:01	0,117	-20,0	-83,9	-32,8	-33,5	-32,8	-30,9	-30,8	98,0	-31,2
2024-09-11	05:26:46	016:40:01	0,119	-20,0	-86,0	-32,9	-33,6	-32,8	-30,9	-30,8	98,1	-31,3
2024-09-11	05:31:46	016:45:01	0,121	-20,0	-86,0	-32,9	-33,6	-32,8	-30,9	-30,8	98,1	-31,2
2024-09-11	05:36:46	016:50:01	0,124	-20,0	-84,4	-32,9	-33,5	-32,8	-30,9	-30,8	98,1	-31,2
2024-09-11	05:41:46	016:55:01	0,127	-20,0	-83,5	-32,8	-33,5	-32,7	-30,8	-30,7	98,2	-31,1
2024-09-11	05:46:46	017:00:01	0,118	-20,0	-84,4	-32,9	-33,5	-32,8	-30,8	-30,7	98,2	-31,1
2024-09-11	05:51:46	017:05:01	0,120	-20,0	-85,7	-32,9	-33,6	-32,8	-30,8	-30,8	98,3	-31,1
2024-09-11	05:56:46	017:10:01	0,123	-20,0	-91,8	-32,9	-33,5	-32,8	-30,8	-30,8	98,3	-31,1
2024-09-11	06:01:46	017:15:01	0,124	-20,0	-93,4	-32,8	-33,5	-32,7	-30,8	-30,7	98,4	-31,0
2024-09-11	06:06:46	017:20:01	0,127	-20,0	-91,6	-32,8	-33,5	-32,7	-30,8	-30,7	98,4	-30,9
2024-09-11	06:11:46	017:25:01	0,118	-20,0	-90,5	-32,9	-33,5	-32,7	-30,8	-30,7	98,5	-31,0
2024-09-11	06:16:46	017:30:01	0,121	-20,0	-87,8	-32,9	-33,6	-32,8	-30,8	-30,7	98,5	-31,0
2024-09-11	06:21:46	017:35:01	0,122	-20,0	-87,6	-32,9	-33,6	-32,7	-30,8	-30,7	98,5	-30,9
2024-09-11	06:26:46	017:40:01	0,125	-20,0	-89,6	-32,8	-33,5	-32,7	-30,7	-30,7	98,6	-30,9

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	16 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-11	06:31:46	017:45:01	0,118	-20,0	-91,1	-32,8	-33,5	-32,6	-30,7	-30,7	98,6	-30,8
2024-09-11	06:36:46	017:50:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-11	06:36:46	017:50:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-11	06:36:46	017:50:01	0,120	-20,0	-92,0	-32,9	-33,5	-32,7	-30,7	-30,7	98,6	-30,9
2024-09-11	06:41:46	017:55:01	0,120	-20,0	-93,9	-32,9	-33,6	-32,7	-30,7	-30,7	98,7	-30,9
2024-09-11	06:46:46	018:00:01	0,123	-20,0	-95,0	-32,9	-33,6	-32,7	-30,7	-30,7	98,7	-30,8
2024-09-11	06:51:46	018:05:01	0,125	-20,0	-91,0	-32,8	-33,5	-32,6	-30,7	-30,7	98,8	-30,7
2024-09-11	06:56:46	018:10:01	0,117	-20,0	-91,8	-32,8	-33,5	-32,6	-30,6	-30,7	98,8	-30,6
2024-09-11	07:01:46	018:15:01	0,119	-20,0	-92,2	-32,9	-33,5	-32,7	-30,7	-30,7	98,9	-30,7
2024-09-11	07:06:46	018:20:01	0,121	-20,0	-92,9	-32,9	-33,6	-32,7	-30,7	-30,7	98,9	-30,6
2024-09-11	07:11:46	018:25:01	0,122	-20,0	-94,0	-32,9	-33,5	-32,6	-30,7	-30,7	99,0	-30,6
2024-09-11	07:16:46	018:30:01	0,125	-20,0	-91,5	-32,8	-33,5	-32,6	-30,6	-30,7	99,0	-30,5
2024-09-11	07:21:46	018:35:01	0,117	-20,0	-93,6	-32,8	-33,5	-32,5	-30,6	-30,6	99,1	-30,4
2024-09-11	07:26:46	018:40:01	0,119	-20,0	-92,1	-32,9	-33,5	-32,6	-30,6	-30,7	99,2	-30,5
2024-09-11	07:31:46	018:45:01	0,121	-20,0	-91,6	-32,9	-33,6	-32,6	-30,6	-30,7	99,2	-30,4
2024-09-11	07:36:46	018:50:01	0,123	-20,0	-93,8	-32,9	-33,5	-32,6	-30,6	-30,7	99,3	-30,3
2024-09-11	07:41:46	018:55:01	0,125	-20,0	-94,2	-32,8	-33,5	-32,5	-30,6	-30,6	99,4	-30,2
2024-09-11	07:46:46	019:00:01	0,118	-20,0	-92,0	-32,8	-33,5	-32,6	-30,5	-30,6	99,5	-30,1
2024-09-11	07:51:46	019:05:01	0,120	-20,0	-91,4	-32,9	-33,6	-32,6	-30,5	-30,7	99,6	-30,1
2024-09-11	07:56:46	019:10:01	0,122	-20,0	-89,7	-32,9	-33,6	-32,6	-30,5	-30,7	99,8	-29,9
2024-09-11	08:01:46	019:15:01	0,124	-20,0	-92,3	-32,9	-33,5	-32,5	-30,5	-30,6	99,9	-29,6

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	17 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-11	08:06:46	019:20:01	0,126	-20,0	-95,0	-32,8	-33,5	-32,5	-30,5	-30,6	100,0	-29,3
2024-09-11	08:11:46	019:25:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-11	08:11:46	019:25:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-11	08:11:46	019:25:01	0,118	-20,0	-95,1	-32,9	-33,5	-32,5	-30,5	-30,6	100,0	-29,1
2024-09-11	08:16:46	019:30:01	0,120	-20,0	-94,1	-32,9	-33,6	-32,6	-30,5	-30,7	100,0	-28,6
2024-09-11	08:21:46	019:35:01	0,122	-20,0	-91,8	-32,9	-33,6	-32,5	-30,5	-30,7	100,0	-28,3
2024-09-11	08:26:46	019:40:01	0,124	-20,0	-91,3	-32,9	-33,5	-32,5	-30,5	-30,6	100,0	-27,9
2024-09-11	08:31:46	019:45:01	0,127	-20,0	-90,1	-32,8	-33,5	-32,4	-30,4	-30,6	100,0	-27,8
2024-09-11	08:36:46	019:50:01	0,119	-20,0	-85,2	-32,9	-33,5	-32,5	-30,4	-30,6	100,0	-27,8
2024-09-11	08:41:46	019:55:01	0,120	-20,0	-92,2	-32,9	-33,6	-32,5	-30,5	-30,6	100,0	-27,7
2024-09-11	08:46:46	020:00:01	0,122	-20,0	-93,8	-32,9	-33,6	-32,5	-30,4	-30,6	100,0	-27,6
2024-09-11	08:51:46	020:05:01	0,125	-20,0	-88,9	-32,9	-33,5	-32,4	-30,4	-30,6	100,0	-27,5
2024-09-11	08:56:46	020:10:01	0,123	-20,0	-90,0	-32,8	-33,5	-32,3	-30,4	-30,6	100,0	-27,4
2024-09-11	09:01:46	020:15:01	0,119	-20,0	-90,3	-32,9	-33,5	-32,4	-30,4	-30,6	100,0	-27,4
2024-09-11	09:06:46	020:20:01	0,121	-20,0	-91,5	-32,9	-33,6	-32,4	-30,4	-30,6	100,0	-27,4
2024-09-11	09:11:46	020:25:01	0,124	-20,0	-84,5	-32,9	-33,6	-32,4	-30,4	-30,6	100,0	-27,3
2024-09-11	09:16:46	020:30:01	0,127	-20,0	-80,4	-32,8	-33,5	-32,3	-30,3	-30,6	100,0	-27,2
2024-09-11	09:21:46	020:35:01	0,119	-20,0	-85,1	-32,9	-33,5	-32,4	-30,3	-30,6	100,0	-27,2
2024-09-11	09:26:46	020:40:01	0,120	-20,0	-84,6	-32,9	-33,6	-32,4	-30,4	-30,6	100,0	-27,1
2024-09-11	09:31:46	020:45:01	0,123	-20,0	-79,5	-32,9	-33,6	-32,3	-30,3	-30,6	100,0	-27,1
2024-09-11	09:36:47	020:50:02	0,124	-20,0	-85,6	-32,9	-33,5	-32,3	-30,3	-30,6	100,0	-27,0

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	18 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-11	09:41:47	020:55:02	0,117	-20,0	-80,6	-32,8	-33,5	-32,2	-30,3	-30,6	100,0	-26,9
2024-09-11	09:46:47	021:00:02	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-11	09:46:47	021:00:02	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-11	09:46:47	021:00:02	0,119	-20,0	-85,5	-32,9	-33,6	-32,3	-30,3	-30,6	100,0	-26,9
2024-09-11	09:51:47	021:05:02	0,120	-20,0	-82,3	-32,9	-33,6	-32,3	-30,3	-30,6	100,0	-26,8
2024-09-11	09:56:47	021:10:02	0,121	-20,0	-94,3	-32,9	-33,6	-32,3	-30,3	-30,6	100,0	-26,7
2024-09-11	10:01:47	021:15:02	0,123	-20,0	-95,5	-32,9	-33,6	-32,3	-30,3	-30,6	100,0	-26,6
2024-09-11	10:06:47	021:20:02	0,125	-20,0	-92,8	-32,9	-33,5	-32,2	-30,2	-30,6	100,0	-26,5
2024-09-11	10:11:47	021:25:02	0,117	-20,0	-93,4	-32,8	-33,5	-32,2	-30,2	-30,5	100,0	-26,5
2024-09-11	10:16:47	021:30:02	0,119	-20,0	-91,5	-32,9	-33,6	-32,3	-30,2	-30,6	100,0	-26,4
2024-09-11	10:21:47	021:35:02	0,120	-20,0	-95,2	-32,9	-33,6	-32,3	-30,2	-30,6	100,0	-26,3
2024-09-11	10:26:47	021:40:02	0,122	-20,0	-96,0	-32,9	-33,6	-32,2	-30,2	-30,6	100,0	-26,3
2024-09-11	10:31:47	021:45:02	0,124	-20,0	-87,2	-32,9	-33,5	-32,2	-30,2	-30,6	100,0	-26,1
2024-09-11	10:36:47	021:50:02	0,117	-20,0	-90,8	-32,8	-33,5	-32,1	-30,1	-30,5	100,0	-25,9
2024-09-11	10:41:47	021:55:02	0,118	-20,0	-93,3	-32,9	-33,6	-32,2	-30,2	-30,6	100,0	-25,6
2024-09-11	10:46:46	022:00:01	0,120	-20,0	-92,2	-32,9	-33,6	-32,2	-30,2	-30,6	100,0	-25,3
2024-09-11	10:51:46	022:05:01	0,122	-20,0	-94,4	-32,9	-33,6	-32,2	-30,2	-30,6	100,0	-25,1
2024-09-11	10:56:46	022:10:01	0,124	-20,0	-86,4	-32,9	-33,5	-32,1	-30,1	-30,5	100,0	-25,0
2024-09-11	11:01:46	022:15:01	0,126	-20,0	-92,0	-32,8	-33,5	-32,1	-30,1	-30,5	100,0	-24,8
2024-09-11	11:06:46	022:20:01	0,118	-20,0	-93,6	-32,9	-33,6	-32,1	-30,1	-30,5	100,0	-24,7
2024-09-11	11:11:46	022:25:01	0,119	-20,0	-87,4	-32,9	-33,6	-32,2	-30,1	-30,6	100,0	-24,6

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	19 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-11	11:16:46	022:30:01	0,122	-20,0	-93,0	-32,9	-33,6	-32,1	-30,1	-30,6	100,0	-24,5
2024-09-11	11:21:46	022:35:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-11	11:21:46	022:35:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-11	11:21:46	022:35:01	0,123	-20,0	-92,9	-32,9	-33,6	-32,1	-30,1	-30,5	100,0	-24,5
2024-09-11	11:26:46	022:40:01	0,125	-20,0	-94,1	-32,8	-33,5	-32,0	-30,0	-30,5	100,0	-24,4
2024-09-11	11:31:46	022:45:01	0,118	-20,0	-91,5	-32,8	-33,5	-32,0	-30,0	-30,5	100,0	-24,3
2024-09-11	11:36:46	022:50:01	0,119	-20,0	-94,5	-32,9	-33,6	-32,1	-30,0	-30,5	100,0	-24,3
2024-09-11	11:41:46	022:55:01	0,121	-20,0	-93,1	-32,9	-33,6	-32,1	-30,0	-30,5	100,0	-24,2
2024-09-11	11:46:46	023:00:01	0,122	-20,0	-94,5	-32,9	-33,6	-32,0	-30,0	-30,5	100,0	-24,1
2024-09-11	11:51:46	023:05:01	0,124	-20,0	-88,5	-32,9	-33,5	-32,0	-30,0	-30,5	100,0	-24,0
2024-09-11	11:56:46	023:10:01	0,117	-20,0	-91,5	-32,8	-33,5	-31,9	-29,9	-30,5	100,0	-24,0
2024-09-11	12:01:46	023:15:01	0,117	-20,0	-92,4	-32,9	-33,6	-32,0	-30,0	-30,5	100,0	-24,0
2024-09-11	12:06:46	023:20:01	0,119	-20,0	-96,5	-32,9	-33,6	-32,0	-30,0	-30,5	100,0	-23,9
2024-09-11	12:11:46	023:25:01	0,121	-20,0	-95,2	-32,9	-33,6	-32,0	-30,0	-30,5	100,0	-23,8
2024-09-11	12:16:46	023:30:01	0,123	-20,0	-94,4	-32,9	-33,6	-31,9	-29,9	-30,5	100,0	-23,8
2024-09-11	12:21:46	023:35:01	0,126	-20,0	-83,4	-32,8	-33,5	-31,8	-29,9	-30,5	100,0	-23,7
2024-09-11	12:26:46	023:40:01	0,117	-20,0	-93,9	-32,9	-33,6	-31,9	-29,9	-30,5	100,0	-23,6
2024-09-11	12:31:46	023:45:01	0,119	-20,0	-93,2	-32,9	-33,6	-31,9	-29,9	-30,5	100,0	-23,6
2024-09-11	12:36:46	023:50:01	0,121	-20,0	-86,5	-32,9	-33,6	-31,8	-29,9	-30,5	100,0	-23,5
2024-09-11	12:41:46	023:55:01	0,125	-20,0	-86,1	-32,9	-33,6	-31,8	-29,9	-30,5	100,0	-23,4
2024-09-11	12:46:46	024:00:01	0,126	-20,0	-91,6	-32,8	-33,5	-31,7	-29,8	-30,4	100,0	-23,3

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	20 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-11	12:51:46	024:05:01	0,118	-20,0	-82,4	-32,8	-33,5	-31,6	-29,8	-30,4	100,0	-23,3
2024-09-11	12:56:46	024:10:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-11	12:56:46	024:10:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-11	12:56:46	024:10:01	0,119	-20,0	-86,4	-32,9	-33,6	-31,6	-29,8	-30,5	100,0	-23,2
2024-09-11	13:01:46	024:15:01	0,121	-20,0	-86,0	-32,9	-33,6	-31,6	-29,8	-30,5	100,0	-23,2
2024-09-11	13:06:46	024:20:01	0,123	-20,0	-84,4	-32,9	-33,6	-31,5	-29,8	-30,4	100,0	-23,1
2024-09-11	13:11:46	024:25:01	0,126	-20,0	-91,4	-32,8	-33,5	-31,4	-29,8	-30,4	100,0	-23,1
2024-09-11	13:16:46	024:30:01	0,126	-20,0	-92,7	-32,8	-33,5	-31,3	-29,7	-30,4	100,0	-23,0
2024-09-11	13:21:46	024:35:01	0,117	-20,0	-94,1	-32,8	-33,5	-31,3	-29,7	-30,4	100,0	-23,0
2024-09-11	13:26:46	024:40:01	0,120	-20,0	-85,9	-32,9	-33,6	-31,3	-29,8	-30,4	100,0	-22,9
2024-09-11	13:31:46	024:45:01	0,121	-20,0	-82,2	-32,9	-33,6	-31,2	-29,8	-30,4	100,0	-22,9
2024-09-11	13:36:46	024:50:01	0,123	-20,0	-87,2	-32,9	-33,6	-31,1	-29,7	-30,4	100,0	-22,8
2024-09-11	13:41:46	024:55:01	0,126	-20,0	-87,9	-32,8	-33,5	-30,9	-29,7	-30,4	100,0	-22,7
2024-09-11	13:46:46	025:00:01	0,118	-20,0	-89,7	-32,8	-33,6	-30,8	-29,7	-30,4	100,0	-22,7
2024-09-11	13:51:46	025:05:01	0,120	-20,0	-87,6	-32,9	-33,6	-30,7	-29,7	-30,4	100,0	-22,6
2024-09-11	13:56:46	025:10:01	0,121	-20,0	-85,2	-32,9	-33,6	-30,4	-29,7	-30,4	100,0	-22,6
2024-09-11	14:01:46	025:15:01	0,123	-20,0	-84,7	-32,8	-33,6	-30,2	-29,7	-30,4	100,0	-22,5
2024-09-11	14:06:46	025:20:01	0,125	-20,0	-85,1	-32,8	-33,5	-30,0	-29,6	-30,4	100,0	-22,5
2024-09-11	14:11:46	025:25:01	0,118	-20,0	-86,6	-32,8	-33,5	-29,9	-29,6	-30,4	100,0	-22,4
2024-09-11	14:16:46	025:30:01	0,118	-20,0	-86,7	-32,9	-33,6	-29,8	-29,6	-30,4	100,0	-22,4
2024-09-11	14:21:46	025:35:01	0,120	-20,0	-94,9	-32,9	-33,6	-29,7	-29,6	-30,4	100,0	-22,4

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	21 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-11	14:26:46	025:40:01	0,121	-20,0	-94,3	-32,9	-33,6	-29,7	-29,6	-30,4	100,0	-22,3
2024-09-11	14:31:46	025:45:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-11	14:31:46	025:45:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-11	14:31:46	025:45:01	0,124	-20,0	-91,7	-32,8	-33,5	-29,6	-29,6	-30,4	100,0	-22,2
2024-09-11	14:36:46	025:50:01	0,125	-20,0	-90,9	-32,8	-33,5	-29,5	-29,5	-30,4	100,0	-22,2
2024-09-11	14:41:46	025:55:01	0,127	-20,0	-92,4	-32,7	-33,4	-29,4	-29,5	-30,3	100,0	-22,1
2024-09-11	14:46:46	026:00:01	0,118	-20,0	-85,1	-32,8	-33,5	-29,4	-29,5	-30,3	100,0	-22,1
2024-09-11	14:51:46	026:05:01	0,119	-20,0	-94,0	-32,8	-33,6	-29,3	-29,5	-30,4	100,0	-22,0
2024-09-11	14:56:46	026:10:01	0,122	-20,0	-86,0	-32,8	-33,5	-29,2	-29,5	-30,4	100,0	-22,0
2024-09-11	15:01:46	026:15:01	0,124	-20,0	-86,9	-32,8	-33,5	-29,2	-29,5	-30,3	100,0	-21,9
2024-09-11	15:06:46	026:20:01	0,125	-20,0	-93,0	-32,7	-33,5	-29,1	-29,4	-30,3	100,0	-21,8
2024-09-11	15:11:46	026:25:01	0,119	-20,0	-94,4	-32,7	-33,4	-29,0	-29,4	-30,3	100,0	-21,8
2024-09-11	15:16:46	026:30:01	0,118	-20,0	-94,1	-32,8	-33,5	-28,9	-29,4	-30,3	100,0	-21,7
2024-09-11	15:21:46	026:35:01	0,119	-20,0	-87,0	-32,8	-33,5	-28,8	-29,4	-30,3	100,0	-21,7
2024-09-11	15:26:46	026:40:01	0,122	-20,0	-83,7	-32,8	-33,5	-28,7	-29,4	-30,3	100,0	-21,6
2024-09-11	15:31:46	026:45:01	0,123	-20,0	-93,2	-32,7	-33,5	-28,6	-29,4	-30,3	100,0	-21,6
2024-09-11	15:36:46	026:50:01	0,126	-20,0	-87,0	-32,7	-33,4	-28,5	-29,3	-30,3	100,0	-21,5
2024-09-11	15:41:46	026:55:01	0,117	-20,0	-90,1	-32,7	-33,4	-28,4	-29,3	-30,3	100,0	-21,5
2024-09-11	15:46:46	027:00:01	0,119	-20,0	-83,2	-32,8	-33,5	-28,3	-29,3	-30,3	100,0	-21,4
2024-09-11	15:51:46	027:05:01	0,120	-20,0	-85,2	-32,8	-33,5	-28,3	-29,3	-30,3	100,0	-21,4
2024-09-11	15:56:46	027:10:01	0,121	-20,0	-92,3	-32,7	-33,5	-28,2	-29,3	-30,3	100,0	-21,3

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	22 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-11	16:01:46	027:15:01	0,122	-20,0	-93,6	-32,7	-33,4	-28,1	-29,3	-30,3	100,0	-21,3
2024-09-11	16:06:46	027:20:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-11	16:06:46	027:20:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-11	16:06:46	027:20:01	0,125	-20,0	-87,0	-32,7	-33,4	-28,0	-29,2	-30,2	100,0	-21,2
2024-09-11	16:11:46	027:25:01	0,126	-20,0	-94,5	-32,6	-33,3	-27,9	-29,2	-30,2	100,0	-21,1
2024-09-11	16:16:46	027:30:01	0,119	-20,0	-93,4	-32,7	-33,4	-27,8	-29,2	-30,2	100,0	-21,1
2024-09-11	16:21:46	027:35:01	0,119	-20,0	-94,2	-32,7	-33,4	-27,7	-29,2	-30,2	100,0	-21,0
2024-09-11	16:26:46	027:40:01	0,120	-20,0	-95,3	-32,7	-33,4	-27,6	-29,2	-30,3	100,0	-21,0
2024-09-11	16:31:46	027:45:01	0,123	-20,0	-95,9	-32,7	-33,4	-27,5	-29,1	-30,2	100,0	-20,9
2024-09-11	16:36:46	027:50:01	0,124	-20,0	-81,8	-32,6	-33,3	-27,4	-29,1	-30,2	100,0	-20,9
2024-09-11	16:41:46	027:55:01	0,127	-20,0	-91,9	-32,6	-33,3	-27,2	-29,1	-30,2	100,0	-20,8
2024-09-11	16:46:46	028:00:01	0,118	-20,0	-89,2	-32,6	-33,3	-27,1	-29,1	-30,2	100,0	-20,8
2024-09-11	16:51:46	028:05:01	0,119	-20,0	-90,7	-32,7	-33,4	-27,0	-29,1	-30,2	100,0	-20,7
2024-09-11	16:56:46	028:10:01	0,121	-20,0	-89,7	-32,7	-33,3	-26,8	-29,0	-30,2	100,0	-20,7
2024-09-11	17:01:46	028:15:01	0,123	-20,0	-93,3	-32,6	-33,3	-26,6	-29,0	-30,2	100,0	-20,6
2024-09-11	17:06:46	028:20:01	0,124	-20,0	-93,9	-32,6	-33,3	-26,4	-29,0	-30,2	100,0	-20,5
2024-09-11	17:11:46	028:25:01	0,126	-20,0	-92,0	-32,5	-33,2	-26,1	-28,9	-30,1	100,0	-20,5
2024-09-11	17:16:46	028:30:01	0,118	-20,0	-90,3	-32,6	-33,2	-25,8	-28,9	-30,1	100,0	-20,5
2024-09-11	17:21:46	028:35:01	0,118	-20,0	-92,9	-32,6	-33,3	-25,5	-28,9	-30,2	100,0	-20,4
2024-09-11	17:26:46	028:40:01	0,119	-20,0	-94,7	-32,6	-33,3	-25,1	-28,9	-30,2	100,0	-20,4
2024-09-11	17:31:46	028:45:01	0,120	-20,0	-95,2	-32,6	-33,3	-24,8	-28,9	-30,2	100,0	-20,3

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	23 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-11	17:36:46	028:50:01	0,122	-20,0	-96,5	-32,5	-33,2	-24,5	-28,8	-30,1	100,0	-20,3
2024-09-11	17:41:46	028:55:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-11	17:41:46	028:55:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-11	17:41:46	028:55:01	0,124	-20,0	-95,6	-32,5	-33,2	-24,4	-28,8	-30,1	100,0	-20,3
2024-09-11	17:46:46	029:00:01	0,126	-20,0	-95,4	-32,4	-33,1	-24,2	-28,7	-30,1	100,0	-20,2
2024-09-11	17:51:46	029:05:01	0,118	-20,0	-95,7	-32,5	-33,1	-24,1	-28,7	-30,1	100,0	-20,1
2024-09-11	17:56:46	029:10:01	0,118	-20,0	-95,7	-32,5	-33,2	-24,1	-28,7	-30,1	100,0	-20,1
2024-09-11	18:01:46	029:15:01	0,120	-20,0	-95,5	-32,5	-33,2	-24,0	-28,7	-30,1	100,0	-20,1
2024-09-11	18:06:46	029:20:01	0,121	-20,0	-95,1	-32,5	-33,2	-23,9	-28,7	-30,1	100,0	-20,0
2024-09-11	18:11:46	029:25:01	0,124	-20,0	-95,9	-32,5	-33,1	-23,9	-28,7	-30,1	100,0	-20,0
2024-09-11	18:16:46	029:30:01	0,126	-20,0	-96,2	-32,4	-33,1	-23,8	-28,7	-30,0	100,0	-20,0
2024-09-11	18:21:46	029:35:01	0,127	-20,0	-94,7	-32,4	-33,0	-23,8	-28,6	-30,0	100,0	-19,9
2024-09-11	18:26:46	029:40:01	0,118	-20,0	-95,2	-32,5	-33,1	-23,7	-28,6	-30,0	100,0	-19,9
2024-09-11	18:31:46	029:45:01	0,119	-20,0	-93,7	-32,5	-33,1	-23,7	-28,7	-30,1	100,0	-19,9
2024-09-11	18:36:46	029:50:01	0,121	-20,0	-85,1	-32,5	-33,1	-23,6	-28,7	-30,1	100,0	-19,8
2024-09-11	18:41:46	029:55:01	0,122	-20,0	-95,1	-32,4	-33,1	-23,6	-28,6	-30,0	100,0	-19,8
2024-09-11	18:46:46	030:00:01	0,124	-20,0	-94,3	-32,4	-33,0	-23,6	-28,6	-30,0	100,0	-19,7
2024-09-11	18:51:46	030:05:01	0,127	-20,0	-94,7	-32,4	-33,0	-23,6	-28,6	-30,0	100,0	-19,7
2024-09-11	18:56:46	030:10:01	0,118	-20,0	-95,0	-32,4	-33,0	-23,5	-28,6	-30,0	100,0	-19,6
2024-09-11	19:01:46	030:15:01	0,119	-20,0	-93,8	-32,5	-33,1	-23,5	-28,6	-30,0	100,0	-19,6
2024-09-11	19:06:46	030:20:01	0,121	-20,0	-93,8	-32,4	-33,1	-23,5	-28,6	-30,0	100,0	-19,6

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	24 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-11	19:11:46	030:25:01	0,122	-20,0	-91,0	-32,4	-33,1	-23,5	-28,6	-30,0	100,0	-19,5
2024-09-11	19:16:46	030:30:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-11	19:16:46	030:30:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-11	19:16:46	030:30:01	0,124	-20,0	-93,3	-32,4	-33,0	-23,5	-28,5	-30,0	100,0	-19,5
2024-09-11	19:21:46	030:35:01	0,125	-20,0	-95,2	-32,3	-33,0	-23,4	-28,5	-30,0	100,0	-19,5
2024-09-11	19:26:46	030:40:01	0,117	-20,0	-94,9	-32,3	-32,9	-23,4	-28,5	-29,9	100,0	-19,4
2024-09-11	19:31:46	030:45:01	0,118	-20,0	-95,4	-32,4	-33,1	-23,4	-28,5	-30,0	100,0	-19,4
2024-09-11	19:36:46	030:50:01	0,119	-20,0	-95,3	-32,5	-33,1	-23,4	-28,5	-30,0	100,0	-19,4
2024-09-11	19:41:46	030:55:01	0,120	-20,0	-96,0	-32,4	-33,1	-23,4	-28,5	-30,0	100,0	-19,3
2024-09-11	19:46:46	031:00:01	0,122	-20,0	-93,8	-32,4	-33,0	-23,3	-28,5	-30,0	100,0	-19,3
2024-09-11	19:51:46	031:05:01	0,124	-20,0	-87,2	-32,3	-33,0	-23,3	-28,5	-30,0	100,0	-19,2
2024-09-11	19:56:46	031:10:01	0,126	-20,0	-92,7	-32,3	-32,9	-23,3	-28,4	-29,9	100,0	-19,2
2024-09-11	20:01:46	031:15:01	0,118	-20,0	-92,6	-32,3	-32,9	-23,3	-28,4	-29,9	100,0	-19,1
2024-09-11	20:06:46	031:20:01	0,119	-20,0	-94,7	-32,4	-33,0	-23,3	-28,4	-30,0	100,0	-19,1
2024-09-11	20:11:46	031:25:01	0,120	-20,0	-94,8	-32,4	-33,0	-23,3	-28,4	-30,0	100,0	-19,1
2024-09-11	20:16:46	031:30:01	0,121	-20,0	-93,9	-32,4	-33,0	-23,2	-28,4	-30,0	100,0	-19,1
2024-09-11	20:21:46	031:35:01	0,124	-20,0	-86,6	-32,3	-32,9	-23,2	-28,4	-30,0	100,0	-19,0
2024-09-11	20:26:46	031:40:01	0,126	-20,0	-88,9	-32,3	-32,9	-23,2	-28,4	-29,9	100,0	-19,0
2024-09-11	20:31:46	031:45:01	0,118	-20,0	-91,2	-32,2	-32,8	-23,2	-28,3	-29,9	100,0	-18,9
2024-09-11	20:36:46	031:50:01	0,118	-20,0	-92,0	-32,3	-33,0	-23,2	-28,4	-30,0	100,0	-18,9
2024-09-11	20:41:46	031:55:01	0,119	-20,0	-91,8	-32,4	-33,0	-23,2	-28,4	-30,0	100,0	-18,9

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	25 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-11	20:46:46	032:00:01	0,122	-20,0	-86,7	-32,3	-33,0	-23,2	-28,4	-30,0	100,0	-18,8
2024-09-11	20:51:46	032:05:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-11	20:51:46	032:05:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-11	20:51:46	032:05:01	0,123	-20,0	-89,2	-32,3	-32,9	-23,1	-28,3	-30,0	100,0	-18,8
2024-09-11	20:56:46	032:10:01	0,125	-20,0	-88,9	-32,2	-32,9	-23,1	-28,3	-29,9	100,0	-18,7
2024-09-11	21:01:46	032:15:01	0,126	-20,0	-94,4	-32,2	-32,8	-23,1	-28,3	-29,9	100,0	-18,6
2024-09-11	21:06:46	032:20:01	0,118	-20,0	-87,3	-32,2	-32,9	-23,1	-28,3	-29,9	100,0	-18,6
2024-09-11	21:11:46	032:25:01	0,119	-20,0	-86,4	-32,3	-32,9	-23,1	-28,3	-29,9	100,0	-18,6
2024-09-11	21:16:46	032:30:01	0,120	-20,0	-89,8	-32,3	-32,9	-23,1	-28,3	-30,0	100,0	-18,5
2024-09-11	21:21:46	032:35:01	0,121	-20,0	-93,9	-32,3	-32,9	-23,1	-28,3	-30,0	100,0	-18,5
2024-09-11	21:26:46	032:40:01	0,123	-20,0	-84,6	-32,2	-32,9	-23,1	-28,3	-29,9	100,0	-18,4
2024-09-11	21:31:46	032:45:01	0,124	-20,0	-94,6	-32,2	-32,8	-23,0	-28,3	-29,9	100,0	-18,4
2024-09-11	21:36:46	032:50:01	0,126	-20,0	-94,5	-32,1	-32,8	-23,0	-28,2	-29,9	100,0	-18,3
2024-09-11	21:41:46	032:55:01	0,118	-20,0	-93,8	-32,2	-32,8	-23,0	-28,2	-29,9	100,0	-18,3
2024-09-11	21:46:46	033:00:01	0,118	-20,0	-94,3	-32,3	-32,9	-23,0	-28,2	-29,9	100,0	-18,2
2024-09-11	21:51:46	033:05:01	0,119	-20,0	-94,0	-32,3	-32,9	-23,0	-28,3	-29,9	100,0	-18,2
2024-09-11	21:56:46	033:10:01	0,121	-20,0	-93,7	-32,2	-32,9	-23,0	-28,2	-29,9	100,0	-18,2
2024-09-11	22:01:46	033:15:01	0,123	-20,0	-93,6	-32,2	-32,8	-23,0	-28,2	-29,9	100,0	-18,1
2024-09-11	22:06:46	033:20:01	0,124	-20,0	-92,5	-32,1	-32,8	-23,0	-28,2	-29,9	100,0	-18,1
2024-09-11	22:11:46	033:25:01	0,126	-20,0	-93,6	-32,1	-32,8	-22,9	-28,1	-29,8	100,0	-18,0
2024-09-11	22:16:46	033:30:01	0,117	-20,0	-94,6	-32,2	-32,8	-22,9	-28,2	-29,9	100,0	-18,0

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	26 / 50	

Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00



2024-09-11	22:21:46	033:35:01	0,118	-20,0	-91,9	-32,2	-32,9	-22,9	-28,2	-29,9	100,0	-17,9
2024-09-11	22:26:46	033:40:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-11	22:26:46	033:40:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-11	22:26:46	033:40:01	0,120	-20,0	-90,9	-32,2	-32,9	-22,9	-28,2	-29,9	100,0	-17,9
2024-09-11	22:31:46	033:45:01	0,121	-20,0	-94,6	-32,2	-32,8	-22,9	-28,2	-29,9	100,0	-17,8
2024-09-11	22:36:46	033:50:01	0,122	-20,0	-93,7	-32,1	-32,8	-22,9	-28,2	-29,9	100,0	-17,7
2024-09-11	22:41:46	033:55:01	0,124	-20,0	-86,2	-32,1	-32,8	-22,8	-28,1	-29,9	100,0	-17,7
2024-09-11	22:46:46	034:00:01	0,126	-20,0	-83,8	-32,0	-32,7	-22,8	-28,1	-29,8	100,0	-17,6
2024-09-11	22:51:46	034:05:01	0,118	-20,0	-89,3	-32,1	-32,8	-22,8	-28,1	-29,9	100,0	-17,5
2024-09-11	22:56:46	034:10:01	0,118	-20,0	-94,8	-32,2	-32,8	-22,8	-28,1	-29,9	100,0	-17,5
2024-09-11	23:01:46	034:15:01	0,119	-20,0	-95,0	-32,2	-32,8	-22,8	-28,1	-29,9	100,0	-17,5
2024-09-11	23:06:46	034:20:01	0,121	-20,0	-88,0	-32,1	-32,8	-22,8	-28,1	-29,9	100,0	-17,4
2024-09-11	23:11:46	034:25:01	0,123	-20,0	-92,2	-32,1	-32,7	-22,8	-28,1	-29,9	100,0	-17,4
2024-09-11	23:16:46	034:30:01	0,124	-20,0	-93,7	-32,1	-32,7	-22,8	-28,0	-29,9	100,0	-17,3
2024-09-11	23:21:46	034:35:01	0,125	-20,0	-93,8	-32,0	-32,6	-22,7	-28,0	-29,8	100,0	-17,3
2024-09-11	23:26:46	034:40:01	0,126	-20,0	-93,1	-32,0	-32,6	-22,7	-28,0	-29,8	100,0	-17,2
2024-09-11	23:31:46	034:45:01	0,118	-20,0	-92,5	-32,1	-32,7	-22,7	-28,0	-29,9	100,0	-17,2
2024-09-11	23:36:46	034:50:01	0,119	-20,0	-92,0	-32,1	-32,7	-22,7	-28,0	-29,9	100,0	-17,1
2024-09-11	23:41:46	034:55:01	0,120	-20,0	-89,2	-32,1	-32,7	-22,7	-28,0	-29,9	100,0	-17,0
2024-09-11	23:46:46	035:00:01	0,122	-20,0	-91,0	-32,1	-32,7	-22,7	-28,0	-29,9	100,0	-17,0
2024-09-11	23:51:46	035:05:01	0,124	-20,0	-84,3	-32,0	-32,6	-22,6	-28,0	-29,8	100,0	-16,9

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:				Seite:	27 / 50

Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00



2024-09-11	23:56:46	035:10:01	0,125	-20,0	-86,0	-32,0	-32,6	-22,6	-27,9	-29,8	100,0	-16,9
2024-09-12	00:01:46	035:15:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-12	00:01:46	035:15:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	00:01:46	035:15:01	0,117	-20,0	-85,2	-32,0	-32,6	-22,6	-27,9	-29,8	100,0	-16,8
2024-09-12	00:06:46	035:20:01	0,118	-20,0	-86,7	-32,1	-32,7	-22,6	-28,0	-29,9	100,0	-16,8
2024-09-12	00:11:46	035:25:01	0,119	-20,0	-85,6	-32,1	-32,7	-22,6	-28,0	-29,9	100,0	-16,7
2024-09-12	00:16:46	035:30:01	0,121	-20,0	-90,7	-32,1	-32,7	-22,6	-28,0	-29,9	100,0	-16,6
2024-09-12	00:21:46	035:35:01	0,121	-20,0	-94,0	-32,0	-32,6	-22,6	-27,9	-29,9	100,0	-16,6
2024-09-12	00:26:46	035:40:01	0,122	-20,0	-90,3	-32,0	-32,6	-22,6	-27,9	-29,8	100,0	-16,5
2024-09-12	00:31:46	035:45:01	0,124	-20,0	-82,3	-32,0	-32,5	-22,5	-27,9	-29,8	100,0	-16,5
2024-09-12	00:36:46	035:50:01	0,126	-20,0	-89,3	-31,9	-32,5	-22,5	-27,8	-29,8	100,0	-16,4
2024-09-12	00:41:46	035:55:01	0,118	-20,0	-93,9	-31,9	-32,4	-22,5	-27,8	-29,8	100,0	-16,3
2024-09-12	00:46:46	036:00:01	0,118	-20,0	-93,5	-32,0	-32,6	-22,5	-27,8	-29,8	100,0	-16,2
2024-09-12	00:51:46	036:05:01	0,119	-20,0	-92,6	-32,0	-32,6	-22,5	-27,9	-29,8	100,0	-16,1
2024-09-12	00:56:46	036:10:01	0,120	-20,0	-94,2	-32,0	-32,6	-22,5	-27,9	-29,8	100,0	-16,0
2024-09-12	01:01:46	036:15:01	0,122	-20,0	-91,6	-32,0	-32,5	-22,4	-27,8	-29,8	100,0	-15,9
2024-09-12	01:06:46	036:20:01	0,123	-20,0	-94,6	-32,0	-32,5	-22,4	-27,8	-29,8	100,0	-15,8
2024-09-12	01:11:46	036:25:01	0,124	-20,0	-94,1	-31,9	-32,4	-22,4	-27,8	-29,8	100,0	-15,8
2024-09-12	01:16:46	036:30:01	0,126	-20,0	-90,2	-31,9	-32,4	-22,4	-27,7	-29,7	100,0	-15,7
2024-09-12	01:18:31	036:31:46	Beginn Alarm: Ölwechsel der Vakuumpumpe durchführen und Zähler rücksetzen. Siehe Menü: Optionen/Service/Ölwechsel Vakuumpumpe. Ausführliche Informationen zum Ölwechsel sind in der Betriebsanleitung der Vakuumpumpe nachzulesen.									

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	28 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-12	01:21:46	036:35:01	0,117	-20,0	-90,3	-31,9	-32,4	-22,4	-27,7	-29,7	100,0	-15,6
2024-09-12	01:26:46	036:40:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-12	01:26:46	036:40:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	01:26:46	036:40:01	0,119	-20,0	-85,0	-32,0	-32,5	-22,4	-27,8	-29,8	100,0	-15,5
2024-09-12	01:31:46	036:45:01	0,120	-20,0	-86,0	-32,0	-32,5	-22,3	-27,8	-29,8	100,0	-15,5
2024-09-12	01:36:46	036:50:01	0,121	-20,0	-90,3	-31,9	-32,4	-22,3	-27,8	-29,8	100,0	-15,4
2024-09-12	01:41:46	036:55:01	0,123	-20,0	-86,9	-31,9	-32,4	-22,3	-27,7	-29,8	100,0	-15,4
2024-09-12	01:46:46	037:00:01	0,124	-20,0	-86,5	-31,9	-32,3	-22,3	-27,7	-29,7	100,0	-15,3
2024-09-12	01:51:46	037:05:01	0,126	-20,0	-84,3	-31,8	-32,3	-22,3	-27,7	-29,7	100,0	-15,3
2024-09-12	01:56:46	037:10:01	0,117	-20,0	-90,2	-31,8	-32,2	-22,3	-27,6	-29,7	100,0	-15,1
2024-09-12	02:01:46	037:15:01	0,118	-20,0	-93,6	-31,9	-32,3	-22,3	-27,7	-29,8	100,0	-15,1
2024-09-12	02:06:46	037:20:01	0,119	-20,0	-92,4	-31,9	-32,3	-22,2	-27,7	-29,8	100,0	-15,0
2024-09-12	02:11:46	037:25:01	0,120	-20,0	-92,3	-31,9	-32,3	-22,2	-27,7	-29,8	100,0	-14,9
2024-09-12	02:16:46	037:30:01	0,121	-20,0	-94,3	-31,9	-32,3	-22,2	-27,7	-29,8	100,0	-14,9
2024-09-12	02:21:46	037:35:01	0,122	-20,0	-93,9	-31,9	-32,2	-22,2	-27,7	-29,8	100,0	-14,9
2024-09-12	02:26:46	037:40:01	0,123	-20,0	-93,7	-31,8	-32,2	-22,2	-27,6	-29,7	100,0	-14,8
2024-09-12	02:31:46	037:45:01	0,124	-20,0	-93,2	-31,8	-32,1	-22,2	-27,6	-29,7	100,0	-14,8
2024-09-12	02:36:46	037:50:01	0,126	-20,0	-85,6	-31,7	-32,0	-22,2	-27,6	-29,7	100,0	-14,8
2024-09-12	02:41:46	037:55:01	0,117	-20,0	-91,1	-31,8	-32,1	-22,1	-27,6	-29,7	100,0	-14,8
2024-09-12	02:46:46	038:00:01	0,119	-20,0	-80,0	-31,8	-32,1	-22,1	-27,6	-29,8	100,0	-14,7
2024-09-12	02:51:46	038:05:01	0,120	-20,0	-94,0	-31,8	-32,1	-22,1	-27,6	-29,7	100,0	-14,7

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	29 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-12	02:56:46	038:10:01	0,120	-20,0	-94,4	-31,8	-32,0	-22,1	-27,6	-29,7	100,0	-14,7
2024-09-12	03:01:46	038:15:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-12	03:01:46	038:15:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	03:01:46	038:15:01	0,122	-20,0	-92,0	-31,8	-31,9	-22,1	-27,6	-29,7	100,0	-14,6
2024-09-12	03:06:46	038:20:01	0,123	-20,0	-94,8	-31,7	-31,8	-22,1	-27,5	-29,7	100,0	-14,6
2024-09-12	03:11:46	038:25:01	0,124	-20,0	-87,3	-31,7	-31,6	-22,1	-27,5	-29,7	100,0	-14,6
2024-09-12	03:16:46	038:30:01	0,126	-20,0	-86,3	-31,7	-31,2	-22,0	-27,5	-29,6	100,0	-14,6
2024-09-12	03:21:46	038:35:01	0,117	-20,0	-93,2	-31,6	-30,6	-22,0	-27,5	-29,6	100,0	-14,6
2024-09-12	03:26:46	038:40:01	0,118	-20,0	-94,1	-31,7	-30,4	-22,0	-27,5	-29,7	100,0	-14,6
2024-09-12	03:31:46	038:45:01	0,119	-20,0	-91,6	-31,7	-30,2	-22,0	-27,5	-29,7	100,0	-14,6
2024-09-12	03:36:46	038:50:01	0,121	-20,0	-87,3	-31,7	-30,0	-22,0	-27,5	-29,7	100,0	-14,6
2024-09-12	03:41:46	038:55:01	0,122	-20,0	-84,7	-31,7	-29,8	-22,0	-27,5	-29,7	100,0	-14,5
2024-09-12	03:46:46	039:00:01	0,123	-20,0	-92,7	-31,6	-29,7	-22,0	-27,4	-29,7	100,0	-14,6
2024-09-12	03:51:46	039:05:01	0,124	-20,0	-92,3	-31,6	-29,5	-21,9	-27,4	-29,6	100,0	-14,5
2024-09-12	03:56:46	039:10:01	0,125	-20,0	-81,0	-31,5	-29,4	-21,9	-27,4	-29,6	100,0	-14,5
2024-09-12	04:01:46	039:15:01	0,126	-20,0	-87,7	-31,5	-29,2	-21,9	-27,4	-29,6	100,0	-14,5
2024-09-12	04:06:46	039:20:01	0,117	-20,0	-95,0	-31,6	-29,2	-21,9	-27,4	-29,6	100,0	-14,5
2024-09-12	04:11:46	039:25:01	0,118	-20,0	-94,5	-31,6	-29,1	-21,9	-27,4	-29,7	100,0	-14,5
2024-09-12	04:16:46	039:30:01	0,119	-20,0	-92,0	-31,6	-29,1	-21,8	-27,4	-29,7	100,0	-14,5
2024-09-12	04:21:46	039:35:01	0,120	-20,0	-92,6	-31,6	-29,0	-21,8	-27,4	-29,7	100,0	-14,5
2024-09-12	04:26:46	039:40:01	0,121	-20,0	-95,2	-31,5	-28,9	-21,8	-27,4	-29,6	100,0	-14,5

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	30 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-12	04:31:46	039:45:01	0,122	-20,0	-91,3	-31,5	-28,8	-21,8	-27,3	-29,6	100,0	-14,4
2024-09-12	04:36:46	039:50:01	Vak.Pira	Stell.Vo	Eiskond1	WTMplus1	WTMplus2	WTMplus3	WTMplus4	WTMplus5	Lyo Rx 1	Lyo Pro1
2024-09-12	04:36:46	039:50:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	04:36:46	039:50:01	0,124	-20,0	-85,9	-31,4	-28,7	-21,8	-27,3	-29,6	100,0	-14,4
2024-09-12	04:41:46	039:55:01	0,125	-20,0	-83,8	-31,4	-28,7	-21,8	-27,3	-29,6	100,0	-14,4
2024-09-12	04:46:46	040:00:01	0,126	-20,0	-85,1	-31,3	-28,6	-21,8	-27,2	-29,5	100,0	-14,4
2024-09-12	04:51:46	040:05:01	0,117	-20,0	-92,3	-31,4	-28,6	-21,7	-27,3	-29,6	100,0	-14,4
2024-09-12	04:56:46	040:10:01	0,119	-20,0	-86,0	-31,4	-28,5	-21,7	-27,3	-29,6	100,0	-14,4
2024-09-12	05:01:46	040:15:01	0,120	-20,0	-91,2	-31,4	-28,5	-21,7	-27,3	-29,6	100,0	-14,4
2024-09-12	05:06:46	040:20:01	0,121	-20,0	-85,2	-31,4	-28,4	-21,7	-27,3	-29,6	100,0	-14,3
2024-09-12	05:11:46	040:25:01	0,122	-20,0	-87,1	-31,3	-28,3	-21,7	-27,2	-29,6	100,0	-14,3
2024-09-12	05:16:46	040:30:01	0,123	-20,0	-85,1	-31,2	-28,3	-21,7	-27,2	-29,5	100,0	-14,3
2024-09-12	05:21:46	040:35:01	0,124	-20,0	-86,5	-31,2	-28,2	-21,6	-27,2	-29,5	100,0	-14,3
2024-09-12	05:26:46	040:40:01	0,125	-20,0	-93,9	-31,1	-28,1	-21,6	-27,1	-29,5	100,0	-14,3
2024-09-12	05:31:46	040:45:01	0,126	-20,0	-85,1	-31,1	-28,0	-21,6	-27,1	-29,5	100,0	-14,3
2024-09-12	05:36:46	040:50:01	0,117	-20,0	-85,9	-31,1	-28,0	-21,6	-27,1	-29,5	100,0	-14,2
2024-09-12	05:41:46	040:55:01	0,118	-20,0	-87,2	-31,1	-28,0	-21,6	-27,2	-29,6	100,0	-14,2
2024-09-12	05:46:46	041:00:01	0,119	-20,0	-86,4	-31,1	-27,9	-21,5	-27,2	-29,6	100,0	-14,2
2024-09-12	05:51:46	041:05:01	0,120	-20,0	-86,7	-31,0	-27,9	-21,5	-27,1	-29,5	100,0	-14,2
2024-09-12	05:56:46	041:10:01	0,121	-20,0	-88,5	-30,9	-27,8	-21,5	-27,1	-29,5	100,0	-14,2
2024-09-12	06:01:46	041:15:01	0,122	-20,0	-86,4	-30,7	-27,7	-21,5	-27,1	-29,5	100,0	-14,2

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	31 / 50	

Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00



2024-09-12	06:06:46	041:20:01	0,123	-20,0	-92,3	-30,5	-27,7	-21,5	-27,1	-29,5	100,0	-14,2
2024-09-12	06:11:46	041:25:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Pro1									
2024-09-12	06:11:46	041:25:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	06:11:46	041:25:01	0,124	-20,0	-85,1	-30,1	-27,6	-21,4	-27,0	-29,4	100,0	-14,2
2024-09-12	06:16:46	041:30:01	0,125	-20,0	-91,4	-29,6	-27,5	-21,4	-27,0	-29,4	100,0	-14,2
2024-09-12	06:21:46	041:35:01	0,125	-20,0	-92,2	-29,4	-27,4	-21,4	-27,0	-29,4	100,0	-14,2
2024-09-12	06:22:36	041:35:51	Alarm: Ölwechsel der Vakuumpumpe durchführen und Zähler rücksetzen. Siehe Menü: Optionen/Service/Ölwechsel Vakuumpumpe. Ausführliche Informationen zum Ölwechsel sind in der Betriebsanleitung der Vakuumpumpe nachzulesen. (1) Alarm bzw. Meldung wurde an der Anlage quittiert!									
2024-09-12	06:26:46	041:40:01	0,117	-20,0	-87,7	-29,2	-27,3	-21,4	-26,9	-29,4	100,0	-14,1
2024-09-12	06:31:46	041:45:01	0,117	-20,0	-92,9	-29,2	-27,3	-21,3	-27,0	-29,5	100,0	-14,1
2024-09-12	06:36:46	041:50:01	0,117	-20,0	-87,1	-29,2	-27,3	-21,3	-27,0	-29,5	100,0	-14,1
2024-09-12	06:41:46	041:55:01	0,118	-20,0	-86,7	-29,1	-27,3	-21,3	-27,0	-29,5	100,0	-14,1
2024-09-12	06:46:46	042:00:01	0,119	-20,0	-87,9	-29,0	-27,2	-21,3	-27,0	-29,4	100,0	-14,1
2024-09-12	06:51:46	042:05:01	0,120	-20,0	-92,0	-28,9	-27,1	-21,3	-26,9	-29,4	100,0	-14,1
2024-09-12	06:56:46	042:10:01	0,122	-20,0	-84,9	-28,8	-27,1	-21,3	-26,9	-29,4	100,0	-14,1
2024-09-12	07:01:46	042:15:01	0,123	-20,0	-87,1	-28,8	-27,0	-21,2	-26,9	-29,4	100,0	-14,0
2024-09-12	07:06:46	042:20:01	0,123	-20,0	-91,3	-28,7	-26,9	-21,2	-26,8	-29,3	100,0	-14,1
2024-09-12	07:11:46	042:25:01	0,124	-20,0	-88,9	-28,6	-26,8	-21,2	-26,8	-29,3	100,0	-14,1
2024-09-12	07:16:46	042:30:01	0,125	-20,0	-92,5	-28,5	-26,8	-21,2	-26,8	-29,3	100,0	-14,0
2024-09-12	07:21:46	042:35:01	0,125	-20,0	-94,7	-28,4	-26,7	-21,1	-26,7	-29,3	100,0	-14,0

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus		Unterschrift:	
Dokument erstellt von:				Seite:	32 / 50

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-12	07:26:46	042:40:01	0,126	-20,0	-92,9	-28,4	-26,6	-21,1	-26,7	-29,2	100,0	-14,0
2024-09-12	07:31:46	042:45:01	0,126	-20,0	-94,4	-28,3	-26,5	-21,1	-26,7	-29,2	100,0	-14,0
2024-09-12	07:36:46	042:50:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Prol									
2024-09-12	07:36:46	042:50:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	07:36:46	042:50:01	0,117	-20,0	-94,5	-28,3	-26,5	-21,1	-26,7	-29,3	100,0	-13,9
2024-09-12	07:41:46	042:55:01	0,118	-20,0	-85,2	-28,3	-26,5	-21,0	-26,7	-29,3	100,0	-13,9
2024-09-12	07:46:46	043:00:01	0,119	-20,0	-94,4	-28,2	-26,4	-21,0	-26,7	-29,3	100,0	-13,9
2024-09-12	07:51:46	043:05:01	0,119	-20,0	-92,6	-28,1	-26,3	-21,0	-26,7	-29,3	100,0	-13,9
2024-09-12	07:56:46	043:10:01	0,120	-20,0	-88,7	-28,1	-26,3	-21,0	-26,7	-29,3	100,0	-13,9
2024-09-12	08:01:46	043:15:01	0,121	-20,0	-86,6	-28,0	-26,2	-21,0	-26,7	-29,2	100,0	-13,9
2024-09-12	08:06:46	043:20:01	0,122	-20,0	-93,8	-28,0	-26,2	-21,0	-26,6	-29,2	100,0	-13,9
2024-09-12	08:11:46	043:25:01	0,122	-20,0	-91,4	-27,9	-26,1	-20,9	-26,6	-29,2	100,0	-13,9
2024-09-12	08:16:46	043:30:01	0,123	-20,0	-81,5	-27,8	-26,0	-20,9	-26,6	-29,1	100,0	-13,9
2024-09-12	08:21:46	043:35:01	0,124	-20,0	-90,4	-27,7	-25,9	-20,9	-26,5	-29,1	100,0	-13,9
2024-09-12	08:26:46	043:40:01	0,125	-20,0	-90,8	-27,6	-25,9	-20,8	-26,5	-29,1	100,0	-13,9
2024-09-12	08:31:46	043:45:01	0,125	-20,0	-92,6	-27,6	-25,8	-20,8	-26,5	-29,1	100,0	-13,8
2024-09-12	08:36:46	043:50:01	0,126	-20,0	-90,0	-27,5	-25,7	-20,8	-26,4	-29,0	100,0	-13,8
2024-09-12	08:41:46	043:55:01	0,127	-20,0	-81,2	-27,4	-25,7	-20,8	-26,4	-29,0	100,0	-13,8
2024-09-12	08:46:46	044:00:01	0,118	-20,0	-91,1	-27,4	-25,6	-20,7	-26,4	-29,1	100,0	-13,7
2024-09-12	08:51:46	044:05:01	0,118	-20,0	-86,8	-27,4	-25,6	-20,7	-26,4	-29,1	100,0	-13,7
2024-09-12	08:56:46	044:10:01	0,119	-20,0	-86,2	-27,3	-25,5	-20,7	-26,4	-29,1	100,0	-13,6

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	33 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-12	09:01:46	044:15:01	0,120	-20,0	-94,3	-27,3	-25,5	-20,6	-26,4	-29,1	100,0	-13,6
2024-09-12	09:06:46	044:20:01	0,121	-20,0	-90,4	-27,2	-25,4	-20,6	-26,4	-29,0	100,0	-13,6
2024-09-12	09:11:46	044:25:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Prol									
2024-09-12	09:11:46	044:25:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	09:11:46	044:25:01	0,121	-20,0	-93,6	-27,1	-25,3	-20,6	-26,3	-29,0	100,0	-13,6
2024-09-12	09:16:46	044:30:01	0,122	-20,0	-93,9	-27,0	-25,3	-20,6	-26,3	-29,0	100,0	-13,6
2024-09-12	09:21:46	044:35:01	0,122	-20,0	-95,5	-27,0	-25,2	-20,5	-26,3	-29,0	100,0	-13,6
2024-09-12	09:26:46	044:40:01	0,123	-20,0	-92,7	-26,9	-25,1	-20,5	-26,3	-28,9	100,0	-13,5
2024-09-12	09:31:46	044:45:01	0,124	-20,0	-92,2	-26,8	-25,0	-20,5	-26,2	-28,9	100,0	-13,5
2024-09-12	09:36:46	044:50:01	0,125	-20,0	-93,6	-26,7	-25,0	-20,4	-26,2	-28,9	100,0	-13,5
2024-09-12	09:41:46	044:55:01	0,125	-20,0	-93,7	-26,6	-24,9	-20,4	-26,2	-28,8	100,0	-13,5
2024-09-12	09:46:46	045:00:01	0,118	-20,0	-86,1	-26,6	-24,8	-20,4	-26,1	-28,8	100,0	-13,5
2024-09-12	09:51:46	045:05:01	0,118	-20,0	-86,6	-26,5	-24,8	-20,3	-26,1	-28,9	100,0	-13,5
2024-09-12	09:56:46	045:10:01	0,119	-20,0	-85,5	-26,4	-24,8	-20,3	-26,2	-28,9	100,0	-13,4
2024-09-12	10:01:46	045:15:01	0,119	-20,0	-85,4	-26,4	-24,7	-20,3	-26,1	-28,9	100,0	-13,4
2024-09-12	10:06:46	045:20:01	0,120	-20,0	-93,9	-26,3	-24,7	-20,3	-26,1	-28,8	100,0	-13,4
2024-09-12	10:11:46	045:25:01	0,120	-20,0	-87,0	-26,2	-24,6	-20,2	-26,1	-28,8	100,0	-13,4
2024-09-12	10:16:46	045:30:01	0,121	-20,0	-84,4	-26,2	-24,6	-20,2	-26,1	-28,8	100,0	-13,4
2024-09-12	10:21:46	045:35:01	0,121	-20,0	-87,4	-26,1	-24,5	-20,2	-26,0	-28,8	100,0	-13,4
2024-09-12	10:26:46	045:40:01	0,122	-20,0	-88,8	-26,0	-24,4	-20,2	-26,0	-28,7	100,0	-13,4
2024-09-12	10:31:46	045:45:01	0,122	-20,0	-85,1	-25,9	-24,4	-20,1	-26,0	-28,7	100,0	-13,4

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	34 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-12	10:36:46	045:50:01	0,123	-20,0	-95,7	-25,8	-24,3	-20,1	-26,0	-28,7	100,0	-13,4
2024-09-12	10:41:46	045:55:01	0,124	-20,0	-87,4	-25,7	-24,3	-20,1	-25,9	-28,7	100,0	-13,4
2024-09-12	10:46:46	046:00:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Prol									
2024-09-12	10:46:46	046:00:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	10:46:46	046:00:01	0,124	-20,0	-87,8	-25,6	-24,2	-20,0	-25,9	-28,6	100,0	-13,3
2024-09-12	10:51:46	046:05:01	0,125	-20,0	-90,8	-25,5	-24,2	-20,0	-25,9	-28,6	100,0	-13,3
2024-09-12	10:56:46	046:10:01	0,125	-20,0	-91,3	-25,4	-24,1	-20,0	-25,8	-28,6	100,0	-13,3
2024-09-12	11:01:46	046:15:01	0,125	-20,0	-94,1	-25,3	-24,0	-19,9	-25,8	-28,5	100,0	-13,3
2024-09-12	11:06:46	046:20:01	0,126	-20,0	-94,3	-25,1	-24,0	-19,9	-25,8	-28,5	100,0	-13,3
2024-09-12	11:11:46	046:25:01	0,125	-20,0	-95,2	-25,0	-23,9	-19,9	-25,8	-28,5	100,0	-13,3
2024-09-12	11:16:46	046:30:01	0,125	-20,0	-94,8	-24,9	-23,8	-19,8	-25,7	-28,4	100,0	-13,3
2024-09-12	11:21:46	046:35:01	0,125	-20,0	-95,8	-24,8	-23,8	-19,8	-25,7	-28,4	100,0	-13,3
2024-09-12	11:26:46	046:40:01	0,126	-20,0	-94,2	-24,7	-23,7	-19,8	-25,7	-28,4	100,0	-13,3
2024-09-12	11:31:46	046:45:01	0,127	-20,0	-95,1	-24,6	-23,7	-19,7	-25,6	-28,4	100,0	-13,2
2024-09-12	11:36:46	046:50:01	0,126	-20,0	-94,6	-24,4	-23,6	-19,7	-25,6	-28,3	100,0	-13,2
2024-09-12	11:41:46	046:55:01	0,118	-20,0	-94,2	-24,3	-23,5	-19,7	-25,6	-28,4	100,0	-13,2
2024-09-12	11:46:46	047:00:01	0,118	-20,0	-94,2	-24,1	-23,5	-19,6	-25,7	-28,4	100,0	-13,2
2024-09-12	11:51:46	047:05:01	0,118	-20,0	-95,4	-24,0	-23,5	-19,6	-25,7	-28,4	100,0	-13,1
2024-09-12	11:56:46	047:10:01	0,118	-20,0	-89,8	-23,8	-23,4	-19,6	-25,6	-28,4	100,0	-13,1
2024-09-12	12:01:46	047:15:01	0,119	-20,0	-94,5	-23,6	-23,4	-19,5	-25,6	-28,4	100,0	-13,1
2024-09-12	12:06:46	047:20:01	0,119	-20,0	-88,2	-23,5	-23,3	-19,5	-25,6	-28,4	100,0	-13,1

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	35 / 50	

Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00



2024-09-12	12:11:46	047:25:01	0,120	-20,0	-95,0	-23,3	-23,2	-19,5	-25,6	-28,3	100,0	-13,1
2024-09-12	12:16:46	047:30:01	0,121	-20,0	-82,2	-23,0	-23,1	-19,4	-25,5	-28,3	100,0	-13,0
2024-09-12	12:21:46	047:35:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Prol									
2024-09-12	12:21:46	047:35:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	12:21:46	047:35:01	0,121	-20,0	-95,3	-22,8	-23,1	-19,4	-25,5	-28,3	100,0	-13,0
2024-09-12	12:26:46	047:40:01	0,122	-20,0	-90,4	-22,5	-23,0	-19,3	-25,4	-28,3	100,0	-13,0
2024-09-12	12:31:46	047:45:01	0,122	-20,0	-88,8	-22,3	-22,9	-19,3	-25,4	-28,2	100,0	-13,0
2024-09-12	12:36:46	047:50:01	0,123	-20,0	-89,2	-22,0	-22,8	-19,2	-25,4	-28,2	100,0	-13,0
2024-09-12	12:41:46	047:55:01	0,123	-20,0	-87,7	-21,7	-22,8	-19,2	-25,3	-28,2	100,0	-13,0
2024-09-12	12:46:46	048:00:01	0,123	-20,0	-91,9	-21,5	-22,7	-19,1	-25,3	-28,2	100,0	-13,0
2024-09-12	12:51:46	048:05:01	0,123	-20,0	-92,4	-21,2	-22,6	-19,1	-25,3	-28,1	100,0	-13,0
2024-09-12	12:56:46	048:10:01	0,124	-20,0	-87,3	-21,0	-22,5	-19,0	-25,2	-28,1	100,0	-12,9
2024-09-12	13:01:46	048:15:01	0,125	-20,0	-88,2	-20,8	-22,4	-19,0	-25,2	-28,1	100,0	-12,9
2024-09-12	13:06:46	048:20:01	0,124	-20,0	-87,7	-20,7	-22,3	-18,9	-25,1	-28,0	100,0	-13,0
2024-09-12	13:11:46	048:25:01	0,125	-20,0	-87,3	-20,5	-22,3	-18,9	-25,1	-28,0	100,0	-12,9
2024-09-12	13:16:46	048:30:01	0,125	-20,0	-90,6	-20,3	-22,2	-18,8	-25,1	-28,0	100,0	-12,9
2024-09-12	13:21:46	048:35:01	0,126	-20,0	-92,6	-20,2	-22,1	-18,8	-25,1	-27,9	100,0	-12,9
2024-09-12	13:26:46	048:40:01	0,126	-20,0	-91,7	-20,0	-22,0	-18,8	-25,0	-27,9	100,0	-12,9
2024-09-12	13:31:46	048:45:01	0,117	-20,0	-94,4	-19,9	-21,9	-18,7	-25,0	-27,9	100,0	-12,9
2024-09-12	13:36:46	048:50:01	0,118	-20,0	-94,9	-19,8	-21,8	-18,7	-25,0	-28,0	100,0	-12,9
2024-09-12	13:41:46	048:55:01	0,118	-20,0	-93,8	-19,7	-21,7	-18,7	-25,0	-28,0	100,0	-12,9

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	36 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-12	13:46:46	049:00:01	0,118	-20,0	-87,4	-19,5	-21,6	-18,6	-25,0	-28,0	100,0	-12,8
2024-09-12	13:51:46	049:05:01	0,119	-20,0	-88,3	-19,4	-21,5	-18,6	-25,0	-27,9	100,0	-12,8
2024-09-12	13:56:46	049:10:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Prol									
2024-09-12	13:56:46	049:10:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	13:56:46	049:10:01	0,119	-20,0	-92,3	-19,3	-21,4	-18,6	-25,0	-27,9	100,0	-12,8
2024-09-12	14:01:46	049:15:01	0,120	-20,0	-90,3	-19,2	-21,3	-18,5	-24,9	-27,9	100,0	-12,8
2024-09-12	14:06:46	049:20:01	0,120	-20,0	-86,8	-19,1	-21,2	-18,5	-24,9	-27,8	100,0	-12,8
2024-09-12	14:11:46	049:25:01	0,121	-20,0	-93,7	-19,0	-21,0	-18,5	-24,9	-27,8	100,0	-12,8
2024-09-12	14:16:46	049:30:01	0,121	-20,0	-93,3	-18,9	-20,9	-18,4	-24,9	-27,8	100,0	-12,7
2024-09-12	14:21:46	049:35:01	0,122	-20,0	-88,8	-18,7	-20,7	-18,4	-24,8	-27,7	100,0	-12,7
2024-09-12	14:26:46	049:40:01	0,122	-20,0	-93,4	-18,6	-20,6	-18,4	-24,8	-27,7	100,0	-12,8
2024-09-12	14:31:46	049:45:01	0,122	-20,0	-92,6	-18,4	-20,5	-18,4	-24,8	-27,7	100,0	-12,7
2024-09-12	14:36:46	049:50:01	0,123	-20,0	-90,8	-18,3	-20,3	-18,3	-24,8	-27,6	100,0	-12,7
2024-09-12	14:41:46	049:55:01	0,123	-20,0	-94,4	-18,1	-20,1	-18,3	-24,7	-27,5	100,0	-12,7
2024-09-12	14:46:46	050:00:01	0,123	-20,0	-90,8	-18,0	-20,0	-18,3	-24,7	-27,5	100,0	-12,7
2024-09-12	14:51:46	050:05:01	0,124	-20,0	-93,7	-17,9	-19,9	-18,3	-24,7	-27,4	100,0	-12,7
2024-09-12	14:56:46	050:10:01	0,126	-20,0	-81,9	-17,9	-19,7	-18,2	-24,7	-27,3	100,0	-12,7
2024-09-12	15:01:46	050:15:01	0,125	-20,0	-95,2	-17,8	-19,6	-18,2	-24,6	-27,2	100,0	-12,7
2024-09-12	15:06:46	050:20:01	0,125	-20,0	-91,6	-17,8	-19,4	-18,2	-24,6	-27,0	100,0	-12,7
2024-09-12	15:11:46	050:25:01	0,125	-20,0	-94,1	-17,7	-19,3	-18,1	-24,6	-26,8	100,0	-12,7
2024-09-12	15:16:46	050:30:01	0,126	-20,0	-94,1	-17,7	-19,2	-18,1	-24,6	-26,5	100,0	-12,7

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	37 / 50	

Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00



2024-09-12	15:21:46	050:35:01	0,127	-20,0	-90,3	-17,7	-19,0	-18,1	-24,6	-26,4	100,0	-12,7
2024-09-12	15:26:46	050:40:01	0,118	-20,0	-93,3	-17,6	-18,9	-18,0	-24,6	-26,3	100,0	-12,7
2024-09-12	15:31:46	050:45:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Prol									
2024-09-12	15:31:46	050:45:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	15:31:46	050:45:01	0,117	-20,0	-87,2	-17,6	-18,8	-18,0	-24,6	-26,2	100,0	-12,6
2024-09-12	15:36:46	050:50:01	0,119	-20,0	-85,9	-17,6	-18,6	-18,0	-24,6	-26,1	100,0	-12,6
2024-09-12	15:41:46	050:55:01	0,119	-20,0	-88,8	-17,5	-18,4	-17,9	-24,6	-26,0	100,0	-12,6
2024-09-12	15:46:46	051:00:01	0,119	-20,0	-87,2	-17,5	-18,3	-17,9	-24,5	-25,9	100,0	-12,6
2024-09-12	15:51:46	051:05:01	0,119	-20,0	-94,4	-17,5	-18,2	-17,9	-24,5	-25,8	100,0	-12,6
2024-09-12	15:53:59	051:07:14	Ende Alarm: Ölwechsel der Vakuumpumpe durchführen und Zähler rücksetzen. Siehe Menü: Optionen/Service/Ölwechsel Vakuumpumpe. Ausführliche Informationen zum Ölwechsel sind in der Betriebsanleitung der Vakuumpumpe nachzulesen.									
2024-09-12	15:56:46	051:10:01	0,120	-20,0	-93,4	-17,4	-18,1	-17,9	-24,5	-25,8	100,0	-12,6
2024-09-12	16:01:46	051:15:01	0,120	-20,0	-92,6	-17,4	-18,0	-17,8	-24,5	-25,7	100,0	-12,6
2024-09-12	16:06:46	051:20:01	0,120	-20,0	-88,6	-17,4	-17,9	-17,8	-24,5	-25,6	100,0	-12,6
2024-09-12	16:11:46	051:25:01	0,121	-20,0	-85,7	-17,3	-17,8	-17,8	-24,4	-25,4	100,0	-12,6
2024-09-12	16:16:46	051:30:01	0,123	-20,0	-91,8	-17,3	-17,7	-17,8	-24,4	-25,3	100,0	-12,6
2024-09-12	16:21:46	051:35:01	0,122	-20,0	-90,3	-17,3	-17,6	-17,7	-24,4	-25,2	100,0	-12,6
2024-09-12	16:26:46	051:40:01	0,123	-20,0	-95,2	-17,3	-17,5	-17,7	-24,4	-25,0	100,0	-12,6
2024-09-12	16:31:46	051:45:01	0,122	-20,0	-90,3	-17,2	-17,5	-17,7	-24,3	-24,9	100,0	-12,5
2024-09-12	16:36:46	051:50:01	0,124	-20,0	-94,7	-17,2	-17,4	-17,7	-24,3	-24,7	100,0	-12,5
2024-09-12	16:41:46	051:55:01	0,123	-20,0	-94,2	-17,2	-17,3	-17,6	-24,3	-24,5	100,0	-12,5

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:				Seite:	38 / 50

Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00



2024-09-12	16:46:46	052:00:01	0,124	-20,0	-95,7	-17,1	-17,2	-17,6	-24,3	-24,3	100,0	-12,5
2024-09-12	16:51:46	052:05:01	0,125	-20,0	-95,2	-17,1	-17,2	-17,6	-24,2	-24,1	100,0	-12,5
2024-09-12	16:56:46	052:10:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Prol									
2024-09-12	16:56:46	052:10:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	16:56:46	052:10:01	0,125	-20,0	-91,9	-17,1	-17,1	-17,5	-24,2	-23,9	100,0	-12,5
2024-09-12	17:01:46	052:15:01	0,125	-20,0	-95,3	-17,1	-17,0	-17,5	-24,2	-23,7	100,0	-12,5
2024-09-12	17:06:46	052:20:01	0,126	-20,0	-94,9	-17,0	-17,0	-17,5	-24,2	-23,5	100,0	-12,5
2024-09-12	17:11:46	052:25:01	0,127	-20,0	-95,0	-17,0	-16,9	-17,5	-24,1	-23,3	100,0	-12,5
2024-09-12	17:16:46	052:30:01	0,126	-20,0	-95,9	-17,0	-16,8	-17,4	-24,1	-23,1	100,0	-12,5
2024-09-12	17:21:46	052:35:01	0,126	-20,0	-86,5	-17,0	-16,7	-17,4	-24,1	-22,9	100,0	-12,5
2024-09-12	17:26:46	052:40:01	0,117	-20,0	-96,6	-16,9	-16,6	-17,4	-24,1	-22,8	100,0	-12,4
2024-09-12	17:31:46	052:45:01	0,118	-20,0	-95,0	-16,9	-16,4	-17,3	-24,1	-22,6	100,0	-12,4
2024-09-12	17:36:46	052:50:01	0,118	-20,0	-95,4	-16,9	-16,3	-17,3	-24,1	-22,4	100,0	-12,4
2024-09-12	17:41:46	052:55:01	0,118	-20,0	-95,3	-16,9	-16,2	-17,3	-24,1	-22,2	100,0	-12,4
2024-09-12	17:46:46	053:00:01	0,119	-20,0	-95,7	-16,8	-16,1	-17,3	-24,1	-22,0	100,0	-12,4
2024-09-12	17:51:46	053:05:01	0,120	-20,0	-93,4	-16,8	-16,0	-17,3	-24,1	-21,7	100,0	-12,4
2024-09-12	17:56:46	053:10:01	0,119	-20,0	-93,9	-16,8	-16,0	-17,2	-24,0	-21,5	100,0	-12,4
2024-09-12	18:01:46	053:15:01	0,120	-20,0	-92,5	-16,8	-15,9	-17,2	-24,0	-21,2	100,0	-12,4
2024-09-12	18:06:46	053:20:01	0,120	-20,0	-88,6	-16,7	-15,9	-17,2	-24,0	-20,9	100,0	-12,4
2024-09-12	18:11:46	053:25:01	0,122	-20,0	-93,5	-16,7	-15,9	-17,1	-24,0	-20,6	100,0	-12,4
2024-09-12	18:16:46	053:30:01	0,121	-20,0	-94,8	-16,7	-15,8	-17,1	-23,9	-20,3	100,0	-12,4

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:				Seite:	39 / 50

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-12	18:21:46	053:35:01	0,122	-20,0	-89,7	-16,7	-15,8	-17,1	-23,9	-20,0	100,0	-12,4
2024-09-12	18:26:46	053:40:01	0,122	-20,0	-88,9	-16,6	-15,8	-17,1	-23,9	-19,7	100,0	-12,4
2024-09-12	18:31:46	053:45:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Prol									
2024-09-12	18:31:46	053:45:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	18:31:46	053:45:01	0,122	-20,0	-90,0	-16,6	-15,8	-17,0	-23,9	-19,5	100,0	-12,4
2024-09-12	18:36:46	053:50:01	0,123	-20,0	-92,5	-16,6	-15,7	-17,0	-23,8	-19,2	100,0	-12,4
2024-09-12	18:41:46	053:55:01	0,123	-20,0	-94,6	-16,6	-15,7	-17,0	-23,8	-18,9	100,0	-12,4
2024-09-12	18:46:46	054:00:01	0,123	-20,0	-93,3	-16,5	-15,7	-16,9	-23,8	-18,7	100,0	-12,4
2024-09-12	18:51:46	054:05:01	0,124	-20,0	-94,2	-16,5	-15,7	-16,9	-23,8	-18,5	100,0	-12,3
2024-09-12	18:56:46	054:10:01	0,124	-20,0	-94,1	-16,5	-15,7	-16,9	-23,8	-18,2	100,0	-12,4
2024-09-12	19:01:46	054:15:01	0,124	-20,0	-83,8	-16,5	-15,6	-16,9	-23,7	-17,9	100,0	-12,4
2024-09-12	19:06:46	054:20:01	0,124	-20,0	-93,3	-16,5	-15,6	-16,8	-23,7	-17,6	100,0	-12,3
2024-09-12	19:11:46	054:25:01	0,124	-20,0	-94,0	-16,4	-15,6	-16,8	-23,7	-17,4	100,0	-12,4
2024-09-12	19:16:46	054:30:01	0,125	-20,0	-89,7	-16,4	-15,6	-16,8	-23,7	-17,3	100,0	-12,4
2024-09-12	19:21:46	054:35:01	0,125	-20,0	-90,8	-16,4	-15,6	-16,8	-23,7	-17,1	100,0	-12,4
2024-09-12	19:26:46	054:40:01	0,125	-20,0	-89,2	-16,4	-15,6	-16,8	-23,6	-17,0	100,0	-12,4
2024-09-12	19:31:46	054:45:01	0,125	-20,0	-93,4	-16,4	-15,5	-16,7	-23,6	-16,9	100,0	-12,4
2024-09-12	19:36:46	054:50:01	0,126	-20,0	-93,0	-16,3	-15,5	-16,7	-23,6	-16,8	100,0	-12,4
2024-09-12	19:41:46	054:55:01	0,126	-20,0	-85,0	-16,3	-15,5	-16,7	-23,6	-16,7	100,0	-12,4
2024-09-12	19:46:46	055:00:01	0,126	-20,0	-93,8	-16,3	-15,5	-16,7	-23,6	-16,7	100,0	-12,3
2024-09-12	19:51:46	055:05:01	0,118	-20,0	-83,3	-16,3	-15,5	-16,7	-23,6	-16,6	100,0	-12,4

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:				Seite:	40 / 50

Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00



2024-09-12	19:56:46	055:10:01	0,118	-20,0	-93,2	-16,2	-15,5	-16,7	-23,6	-16,6	100,0	-12,4
2024-09-12	20:01:46	055:15:01	0,118	-20,0	-90,1	-16,2	-15,5	-16,6	-23,6	-16,5	100,0	-12,3
2024-09-12	20:06:46	055:20:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Prol									
2024-09-12	20:06:46	055:20:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	20:06:46	055:20:01	0,119	-20,0	-81,9	-16,2	-15,5	-16,6	-23,6	-16,5	100,0	-12,3
2024-09-12	20:11:46	055:25:01	0,119	-20,0	-87,3	-16,2	-15,4	-16,6	-23,6	-16,4	100,0	-12,3
2024-09-12	20:16:46	055:30:01	0,119	-20,0	-90,7	-16,2	-15,4	-16,6	-23,6	-16,4	100,0	-12,3
2024-09-12	20:21:46	055:35:01	0,120	-20,0	-90,5	-16,2	-15,4	-16,6	-23,6	-16,4	100,0	-12,3
2024-09-12	20:26:46	055:40:01	0,120	-20,0	-80,4	-16,1	-15,4	-16,6	-23,6	-16,3	100,0	-12,3
2024-09-12	20:31:46	055:45:01	0,121	-20,0	-82,4	-16,1	-15,4	-16,5	-23,6	-16,3	100,0	-12,3
2024-09-12	20:36:46	055:50:01	0,121	-20,0	-83,2	-16,1	-15,4	-16,5	-23,6	-16,3	100,0	-12,3
2024-09-12	20:41:46	055:55:01	0,121	-20,0	-94,5	-16,1	-15,4	-16,5	-23,6	-16,3	100,0	-12,3
2024-09-12	20:46:46	056:00:01	0,121	-20,0	-86,8	-16,1	-15,3	-16,5	-23,5	-16,2	100,0	-12,3
2024-09-12	20:51:46	056:05:01	0,122	-20,0	-82,2	-16,1	-15,3	-16,5	-23,5	-16,2	100,0	-12,3
2024-09-12	20:56:46	056:10:01	0,123	-20,0	-87,4	-16,1	-15,3	-16,5	-23,5	-16,2	100,0	-12,3
2024-09-12	21:01:46	056:15:01	0,123	-20,0	-92,2	-16,1	-15,3	-16,4	-23,5	-16,2	100,0	-12,3
2024-09-12	21:06:46	056:20:01	0,123	-20,0	-87,7	-16,1	-15,3	-16,4	-23,5	-16,1	100,0	-12,3
2024-09-12	21:11:46	056:25:01	0,123	-20,0	-85,7	-16,1	-15,3	-16,4	-23,5	-16,1	100,0	-12,4
2024-09-12	21:13:09	056:26:24	Betriebsart: Run - Programm - Nachtrocknen - Prg-Nr 8 - Abs. 9 (5:50 hhh:mm 50,0 °C 0,120 mBar)									
2024-09-12	21:16:46	056:30:01	0,123	-19,4	-91,6	-16,1	-15,3	-16,4	-23,5	-16,1	100,0	-12,3

Aufzeichnungsbeginn: 2024-09-10 12:46:45 Aufzeichnungsende: 2024-09-13 9:35:41 Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):68:48:55
 Produkt-Nr.: \pdaconservative Produkt-Name:
 Batch-Nr.: Batch-Name:
 Batch-Größe: Batch Volumen pro Einheit:
 Notiz:
 Dokument erstellt am: 2024-09-18 09:46:51 LPCplus
 Dokument erstellt von: Unterschrift: Seite: 41 / 50

Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00



2024-09-12	21:21:46	056:35:01	0,125	-18,4	-80,8	-16,0	-15,2	-16,3	-23,3	-16,0	100,0	-12,3
2024-09-12	21:26:46	056:40:01	0,126	-17,3	-84,7	-15,8	-15,1	-16,1	-23,0	-15,9	100,0	-12,1
2024-09-12	21:31:46	056:45:01	0,119	-16,3	-89,0	-15,6	-14,8	-15,9	-22,7	-15,6	100,0	-11,8
2024-09-12	21:36:46	056:50:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Prol									
2024-09-12	21:36:46	056:50:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	21:36:46	056:50:01	0,120	-15,3	-88,8	-15,2	-14,5	-15,5	-22,4	-15,3	100,0	-11,5
2024-09-12	21:41:46	056:55:01	0,121	-14,3	-89,3	-14,8	-14,2	-15,1	-22,1	-14,9	100,0	-11,2
2024-09-12	21:46:46	057:00:01	0,123	-13,3	-85,1	-14,4	-13,7	-14,6	-21,7	-14,5	100,0	-10,8
2024-09-12	21:51:46	057:05:01	0,124	-12,3	-87,0	-13,9	-13,3	-14,1	-21,3	-14,0	100,0	-10,3
2024-09-12	21:56:46	057:10:01	0,125	-11,3	-93,4	-13,4	-12,8	-13,6	-20,9	-13,5	100,0	-9,9
2024-09-12	22:01:46	057:15:01	0,126	-10,3	-90,1	-12,8	-12,2	-13,0	-20,5	-13,0	100,0	-9,4
2024-09-12	22:06:46	057:20:01	0,118	-9,3	-90,7	-12,2	-11,7	-12,4	-20,1	-12,4	100,0	-8,8
2024-09-12	22:11:46	057:25:01	0,119	-8,3	-95,2	-11,7	-11,1	-11,8	-19,8	-11,9	100,0	-8,3
2024-09-12	22:16:46	057:30:01	0,120	-7,3	-90,7	-11,1	-10,5	-11,2	-19,4	-11,3	100,0	-7,7
2024-09-12	22:21:46	057:35:01	0,122	-6,3	-85,9	-10,4	-9,9	-10,6	-19,0	-10,7	100,0	-7,1
2024-09-12	22:26:46	057:40:01	0,123	-5,3	-87,4	-9,8	-9,3	-9,9	-18,5	-10,0	100,0	-6,6
2024-09-12	22:31:46	057:45:01	0,124	-4,3	-90,9	-9,1	-8,6	-9,3	-18,1	-9,4	100,0	-6,0
2024-09-12	22:36:46	057:50:01	0,126	-3,3	-82,7	-8,5	-7,9	-8,6	-17,7	-8,8	100,0	-5,3
2024-09-12	22:41:46	057:55:01	0,118	-2,3	-91,0	-7,8	-7,3	-7,8	-17,3	-8,1	100,0	-4,7
2024-09-12	22:46:46	058:00:01	0,119	-1,3	-89,2	-7,1	-6,6	-7,1	-17,0	-7,4	100,0	-4,1
2024-09-12	22:51:46	058:05:01	0,120	-0,3	-88,9	-6,4	-5,9	-6,4	-16,6	-6,8	100,0	-3,5

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:				Seite:	42 / 50

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-12	22:56:46	058:10:01	0,122	0,7	-82,4	-5,7	-5,2	-5,7	-16,2	-6,1	100,0	-2,8
2024-09-12	23:01:46	058:15:01	0,123	1,7	-89,6	-5,0	-4,5	-5,0	-15,8	-5,4	100,0	-2,2
2024-09-12	23:06:46	058:20:01	0,125	2,7	-88,9	-4,3	-3,8	-4,2	-15,3	-4,7	100,0	-1,5
2024-09-12	23:11:46	058:25:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Prol									
2024-09-12	23:11:46	058:25:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-12	23:11:46	058:25:01	0,125	3,7	-87,6	-3,6	-3,1	-3,5	-14,9	-3,9	100,0	-0,9
2024-09-12	23:16:46	058:30:01	0,126	4,7	-91,1	-2,8	-2,3	-2,7	-14,5	-3,2	100,0	-0,2
2024-09-12	23:21:46	058:35:01	0,117	5,7	-89,3	-2,1	-1,6	-2,0	-14,2	-2,5	100,0	0,4
2024-09-12	23:26:46	058:40:01	0,118	6,7	-88,2	-1,4	-0,8	-1,2	-13,9	-1,7	100,0	1,1
2024-09-12	23:31:46	058:45:01	0,119	7,7	-83,0	-0,6	-0,1	-0,5	-13,5	-1,0	100,0	1,8
2024-09-12	23:36:46	058:50:01	0,120	8,7	-83,3	0,1	0,6	0,3	-13,1	-0,3	100,0	2,4
2024-09-12	23:41:46	058:55:01	0,122	9,7	-87,3	0,9	1,4	1,0	-12,6	0,5	100,0	3,1
2024-09-12	23:46:46	059:00:01	0,123	10,7	-90,2	1,6	2,2	1,8	-12,2	1,3	100,0	3,8
2024-09-12	23:51:46	059:05:01	0,123	11,7	-92,3	2,4	3,0	2,6	-11,7	2,0	100,0	4,5
2024-09-12	23:56:46	059:10:01	0,123	12,7	-93,4	3,2	3,8	3,4	-11,3	2,8	100,0	5,2
2024-09-13	00:01:46	059:15:01	0,124	13,7	-89,9	4,0	4,6	4,2	-10,9	3,6	100,0	5,9
2024-09-13	00:06:46	059:20:01	0,124	14,7	-91,4	4,8	5,4	5,0	-10,4	4,4	100,0	6,6
2024-09-13	00:11:46	059:25:01	0,124	15,7	-91,3	5,6	6,2	5,8	-9,9	5,3	100,0	7,3
2024-09-13	00:16:46	059:30:01	0,124	16,7	-91,6	6,4	7,1	6,7	-9,4	6,1	100,0	8,0
2024-09-13	00:21:46	059:35:01	0,125	17,7	-85,1	7,2	7,9	7,5	-8,9	6,9	100,0	8,7
2024-09-13	00:26:46	059:40:01	0,126	18,7	-91,3	8,1	8,8	8,4	-8,4	7,8	100,0	9,4

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	43 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-13	00:31:46	059:45:01	0,125	19,7	-85,8	8,9	9,6	9,2	-7,8	8,6	100,0	10,2
2024-09-13	00:36:46	059:50:01	0,126	20,7	-88,5	9,7	10,5	10,1	-7,2	9,5	100,0	10,9
2024-09-13	00:41:46	059:55:01	0,126	21,7	-88,4	10,6	11,4	11,0	-6,4	10,4	100,0	11,6
2024-09-13	00:46:46	060:00:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Prol									
2024-09-13	00:46:46	060:00:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-13	00:46:46	060:00:01	0,118	22,8	-82,2	11,4	12,3	11,8	-5,7	11,3	100,0	12,4
2024-09-13	00:51:46	060:05:01	0,119	23,7	-89,0	12,3	13,1	12,7	-4,9	12,1	100,0	13,1
2024-09-13	00:56:46	060:10:01	0,120	24,7	-82,9	13,1	14,0	13,6	-3,7	13,0	100,0	13,8
2024-09-13	01:01:46	060:15:01	0,119	25,7	-86,4	14,0	14,8	14,5	-2,5	13,9	100,0	14,5
2024-09-13	01:06:46	060:20:01	0,119	26,7	-90,9	14,9	15,7	15,4	-0,9	14,8	100,0	15,3
2024-09-13	01:11:46	060:25:01	0,118	27,7	-89,7	15,7	16,5	16,3	0,8	15,6	100,0	16,0
2024-09-13	01:16:46	060:30:01	0,118	28,7	-91,8	16,6	17,4	17,2	2,4	16,5	100,0	16,8
2024-09-13	01:21:46	060:35:01	0,117	29,7	-90,7	17,5	18,2	18,1	4,1	17,4	100,0	17,5
2024-09-13	01:26:46	060:40:01	0,117	30,7	-92,7	18,3	19,1	19,0	5,8	18,2	100,0	18,2
2024-09-13	01:31:46	060:45:01	0,116	31,7	-92,7	19,2	19,9	19,8	7,6	19,0	100,0	19,0
2024-09-13	01:36:46	060:50:01	0,116	32,7	-87,3	20,0	20,6	20,7	9,6	19,9	100,0	19,7
2024-09-13	01:41:46	060:55:01	0,115	33,7	-90,5	20,8	21,4	21,5	12,1	20,7	100,0	20,5
2024-09-13	01:46:46	061:00:01	0,115	34,8	-91,3	21,6	22,2	22,5	15,6	21,5	100,0	21,3
2024-09-13	01:51:46	061:05:01	0,114	35,8	-92,9	22,5	23,2	23,7	18,8	22,5	100,0	22,0
2024-09-13	01:56:46	061:10:01	0,115	36,7	-83,0	23,6	24,3	24,8	21,2	23,5	100,0	22,8
2024-09-13	02:01:46	061:15:01	0,118	37,7	-85,1	24,8	25,4	25,9	23,0	24,6	100,0	23,6

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	44 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-13	02:06:46	061:20:01	0,120	38,7	-87,3	25,9	26,4	27,0	24,8	25,6	100,0	24,3
2024-09-13	02:11:46	061:25:01	0,119	39,7	-91,3	26,9	27,4	28,0	26,4	26,6	100,0	25,1
2024-09-13	02:16:46	061:30:01	0,120	40,7	-90,5	27,9	28,4	29,0	27,6	27,6	100,0	25,9
2024-09-13	02:21:46	061:35:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Prol									
2024-09-13	02:21:46	061:35:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-13	02:21:46	061:35:01	0,122	41,7	-88,5	28,9	29,3	30,0	28,7	28,5	100,0	26,6
2024-09-13	02:26:46	061:40:01	0,123	42,7	-88,8	29,9	30,2	30,9	29,7	29,5	100,0	27,5
2024-09-13	02:31:46	061:45:01	0,124	43,8	-87,6	30,8	31,1	31,9	30,6	30,4	100,0	28,2
2024-09-13	02:36:46	061:50:01	0,118	44,7	-85,6	31,8	32,1	32,9	31,5	31,3	100,0	29,0
2024-09-13	02:41:46	061:55:01	0,120	45,7	-89,1	32,7	33,0	33,8	32,4	32,2	100,0	29,8
2024-09-13	02:46:46	062:00:01	0,120	46,7	-92,1	33,6	33,9	34,7	33,3	33,1	100,0	30,6
2024-09-13	02:51:46	062:05:01	0,121	47,7	-91,2	34,6	34,8	35,6	34,2	34,1	100,0	31,4
2024-09-13	02:56:46	062:10:01	0,122	48,7	-91,4	35,5	35,7	36,5	35,1	35,0	100,0	32,1
2024-09-13	03:01:46	062:15:01	0,124	49,7	-89,5	36,4	36,6	37,4	36,0	35,9	100,0	32,9
2024-09-13	03:03:07	062:16:22	Betriebsart: Run - Programm - Nachtrocknen - Prg-Nr 8 - Abs. 10 (2:00 hhh:mm 50,0 °C 0,120 mBar)									
2024-09-13	03:06:46	062:20:01	0,127	50,1	-89,5	37,3	37,5	38,3	36,9	36,8	100,0	33,6
2024-09-13	03:11:46	062:25:01	0,119	50,0	-89,1	38,2	38,4	39,1	37,7	37,7	100,0	34,3
2024-09-13	03:16:46	062:30:01	0,119	50,0	-90,1	38,9	39,1	39,8	38,4	38,4	100,0	34,9
2024-09-13	03:21:46	062:35:01	0,121	50,0	-81,0	39,6	39,7	40,4	39,0	39,1	100,0	35,4
2024-09-13	03:26:46	062:40:01	0,123	50,0	-90,9	40,1	40,2	40,9	39,6	39,6	100,0	35,8

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	45 / 50	

Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00



2024-09-13	03:31:46	062:45:01	0,123	50,0	-91,8	40,6	40,7	41,3	40,1	40,1	100,0	36,2
2024-09-13	03:36:46	062:50:01	0,124	50,0	-90,2	41,1	41,1	41,7	40,5	40,6	100,0	36,5
2024-09-13	03:41:46	062:55:01	0,124	50,0	-91,5	41,4	41,5	42,0	40,9	41,0	100,0	36,8
2024-09-13	03:46:46	063:00:01	0,126	50,0	-86,9	41,8	41,8	42,3	41,2	41,3	100,0	37,0
2024-09-13	03:51:46	063:05:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Pro1									
2024-09-13	03:51:46	063:05:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-13	03:51:46	063:05:01	0,119	50,0	-91,2	42,1	42,1	42,5	41,5	41,6	100,0	37,3
2024-09-13	03:56:46	063:10:01	0,120	50,0	-91,2	42,3	42,3	42,8	41,8	41,9	100,0	37,4
2024-09-13	04:01:46	063:15:01	0,121	50,0	-90,9	42,5	42,5	42,9	42,0	42,1	100,0	37,6
2024-09-13	04:06:46	063:20:01	0,122	50,0	-89,1	42,7	42,7	43,1	42,2	42,3	100,0	37,7
2024-09-13	04:11:46	063:25:01	0,123	50,0	-90,2	42,9	42,9	43,3	42,4	42,5	100,0	37,9
2024-09-13	04:16:46	063:30:01	0,124	50,0	-91,1	43,1	43,0	43,4	42,6	42,7	100,0	38,0
2024-09-13	04:21:46	063:35:01	0,125	50,0	-87,5	43,2	43,2	43,5	42,7	42,9	100,0	38,1
2024-09-13	04:26:46	063:40:01	0,126	50,0	-90,3	43,4	43,3	43,7	42,9	43,0	100,0	38,3
2024-09-13	04:31:46	063:45:01	0,119	50,0	-91,3	43,5	43,4	43,8	43,0	43,1	100,0	38,4
2024-09-13	04:36:46	063:50:01	0,119	50,0	-91,6	43,6	43,5	43,8	43,1	43,2	100,0	38,4
2024-09-13	04:41:46	063:55:01	0,120	50,0	-91,8	43,7	43,6	43,9	43,2	43,3	100,0	38,5
2024-09-13	04:46:46	064:00:01	0,123	50,0	-89,3	43,8	43,7	44,0	43,3	43,4	100,0	38,6
2024-09-13	04:51:46	064:05:01	0,124	50,0	-90,1	43,9	43,8	44,1	43,4	43,5	100,0	38,7
2024-09-13	04:56:46	064:10:01	0,124	50,0	-90,6	44,0	43,8	44,1	43,5	43,6	100,0	38,7
2024-09-13	05:01:46	064:15:01	0,124	50,0	-90,7	44,0	43,9	44,2	43,6	43,7	100,0	38,8

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:				Seite:	46 / 50

Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00



2024-09-13	05:03:07	064:16:22	Betriebsart: Run - Programm - Nachtrocknen - Prg-Nr 8 - Abs. 11 (0:30 hhh:mm 20,0 °C 0,120 mBar)									
2024-09-13	05:06:46	064:20:01	0,118	46,8	-81,0	44,1	43,9	44,2	43,6	43,7	100,0	38,8
2024-09-13	05:11:46	064:25:01	0,120	41,9	-82,3	43,8	43,7	43,9	43,4	43,5	100,0	38,1
2024-09-13	05:16:46	064:30:01	0,122	36,9	-80,1	43,1	43,0	42,8	42,6	42,6	100,0	36,8
2024-09-13	05:21:46	064:35:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Pro1									
2024-09-13	05:21:46	064:35:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-13	05:21:46	064:35:01	0,123	31,4	-74,8	41,8	41,8	41,3	41,4	41,3	100,0	35,2
2024-09-13	05:26:46	064:40:01	0,124	26,0	-76,3	40,1	40,1	39,3	39,8	39,5	100,0	33,2
2024-09-13	05:31:46	064:45:01	0,124	21,7	-85,1	38,0	38,1	37,0	37,8	37,3	100,0	31,1
2024-09-13	05:33:08	064:46:23	Meldung: Programm beendet. In Standby-Modus wechseln?									
2024-09-13	05:36:46	064:50:01	0,122	19,9	-88,3	35,6	35,8	34,5	35,6	34,9	100,0	29,0
2024-09-13	05:41:46	064:55:01	0,120	20,0	-91,9	33,3	33,5	32,1	33,5	32,6	100,0	27,1
2024-09-13	05:46:46	065:00:01	0,120	20,0	-92,7	31,3	31,6	30,3	31,6	30,7	100,0	25,7
2024-09-13	05:51:46	065:05:01	0,120	20,0	-92,6	29,6	30,0	28,9	30,0	29,2	100,0	24,5
2024-09-13	05:56:46	065:10:01	0,121	20,0	-94,6	28,3	28,7	27,7	28,7	27,9	100,0	23,6
2024-09-13	06:01:46	065:15:01	0,120	20,0	-94,1	27,1	27,5	26,6	27,6	26,9	100,0	22,8
2024-09-13	06:06:46	065:20:01	0,120	20,0	-93,6	26,2	26,5	25,7	26,6	25,9	100,0	22,1
2024-09-13	06:11:46	065:25:01	0,121	20,0	-94,6	25,3	25,6	25,0	25,7	25,2	100,0	21,6
2024-09-13	06:16:46	065:30:01	0,121	20,0	-94,3	24,6	24,9	24,3	25,0	24,5	100,0	21,1
2024-09-13	06:21:46	065:35:01	0,122	20,0	-93,6	24,0	24,3	23,8	24,3	23,9	100,0	20,7

Aufzeichnungsbeginn: 2024-09-10 12:46:45 Aufzeichnungsende: 2024-09-13 9:35:41 Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):68:48:55
 Produkt-Nr.: \pdaconservative Produkt-Name:
 Batch-Nr.: Batch-Name:
 Batch-Größe: Batch Volumen pro Einheit:
 Notiz:
 Dokument erstellt am: 2024-09-18 09:46:51 LPCplus
 Dokument erstellt von: Unterschrift: Seite: 47 / 50

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-13	06:26:46	065:40:01	0,122	20,0	-94,0	23,5	23,7	23,3	23,8	23,4	100,0	20,4
2024-09-13	06:31:46	065:45:01	0,123	20,0	-94,0	23,0	23,3	22,9	23,3	23,0	100,0	20,1
2024-09-13	06:36:46	065:50:01	0,123	20,0	-94,3	22,6	22,9	22,5	22,9	22,6	100,0	19,9
2024-09-13	06:41:46	065:55:01	0,124	20,0	-93,8	22,3	22,6	22,2	22,5	22,3	100,0	19,6
2024-09-13	06:46:46	066:00:01	0,124	20,0	-94,0	22,0	22,3	22,0	22,2	22,0	100,0	19,4
2024-09-13	06:51:46	066:05:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Pro1									
2024-09-13	06:51:46	066:05:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-13	06:51:46	066:05:01	0,125	20,0	-93,8	21,8	22,0	21,8	22,0	21,8	100,0	19,3
2024-09-13	06:56:46	066:10:01	0,125	20,0	-94,0	21,6	21,8	21,6	21,8	21,6	100,0	19,2
2024-09-13	07:01:46	066:15:01	0,126	20,0	-94,3	21,4	21,6	21,4	21,6	21,4	100,0	19,0
2024-09-13	07:06:46	066:20:01	0,126	20,0	-93,3	21,3	21,5	21,3	21,4	21,3	100,0	18,9
2024-09-13	07:11:46	066:25:01	0,126	20,0	-93,6	21,1	21,3	21,1	21,3	21,2	100,0	18,9
2024-09-13	07:16:46	066:30:01	0,119	20,0	-94,6	21,0	21,2	21,0	21,1	21,0	100,0	18,8
2024-09-13	07:21:46	066:35:01	0,119	20,0	-93,7	20,9	21,1	20,9	21,0	20,9	100,0	18,7
2024-09-13	07:26:46	066:40:01	0,119	20,0	-94,1	20,8	21,0	20,8	20,9	20,9	100,0	18,6
2024-09-13	07:31:46	066:45:01	0,120	20,0	-94,5	20,8	21,0	20,8	20,8	20,8	100,0	18,6
2024-09-13	07:36:46	066:50:01	0,120	20,0	-94,3	20,7	20,9	20,7	20,8	20,7	100,0	18,5
2024-09-13	07:41:46	066:55:01	0,121	20,0	-93,9	20,6	20,8	20,6	20,7	20,7	100,0	18,5
2024-09-13	07:46:46	067:00:01	0,121	20,0	-93,9	20,6	20,8	20,6	20,6	20,6	100,0	18,4
2024-09-13	07:51:46	067:05:01	0,122	20,0	-94,9	20,5	20,7	20,5	20,6	20,6	100,0	18,4
2024-09-13	07:56:46	067:10:01	0,122	20,0	-94,6	20,5	20,7	20,5	20,5	20,5	100,0	18,3

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	48 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-13	08:01:46	067:15:01	0,123	20,0	-94,5	20,5	20,6	20,5	20,5	20,5	100,0	18,3
2024-09-13	08:06:46	067:20:01	0,123	20,0	-94,2	20,4	20,6	20,4	20,4	20,4	100,0	18,2
2024-09-13	08:11:46	067:25:01	0,124	20,0	-94,3	20,4	20,5	20,4	20,4	20,4	100,0	18,2
2024-09-13	08:16:46	067:30:01	0,125	20,0	-95,5	20,4	20,5	20,4	20,4	20,4	100,0	18,2
2024-09-13	08:21:46	067:35:01	0,125	20,0	-94,0	20,3	20,5	20,4	20,4	20,4	100,0	18,2
2024-09-13	08:26:46	067:40:01	Vak.Pira Stell.Vo Eiskond1 WTMplus1 WTMplus2 WTMplus3 WTMplus4 WTMplus5 Lyo Rx 1 Lyo Pro1									
2024-09-13	08:26:46	067:40:01	mBar	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	%	°C
2024-09-13	08:26:46	067:40:01	0,125	20,0	-94,0	20,3	20,5	20,3	20,3	20,3	100,0	18,1
2024-09-13	08:31:46	067:45:01	0,125	20,0	-94,9	20,3	20,4	20,3	20,3	20,3	100,0	18,1
2024-09-13	08:36:46	067:50:01	0,126	20,0	-93,8	20,3	20,4	20,3	20,3	20,3	100,0	18,1
2024-09-13	08:41:46	067:55:01	0,126	20,0	-93,7	20,3	20,4	20,3	20,3	20,3	100,0	18,1
2024-09-13	08:46:46	068:00:01	0,118	20,0	-94,2	20,2	20,4	20,3	20,2	20,3	100,0	18,0
2024-09-13	08:51:46	068:05:01	0,119	20,0	-95,0	20,2	20,4	20,2	20,2	20,2	100,0	18,0
2024-09-13	08:56:46	068:10:01	0,119	20,0	-94,9	20,2	20,4	20,2	20,2	20,2	100,0	18,0
2024-09-13	09:01:46	068:15:01	0,120	20,0	-94,0	20,2	20,4	20,2	20,2	20,2	100,0	18,0
2024-09-13	09:06:46	068:20:01	0,120	20,0	-93,8	20,2	20,3	20,2	20,2	20,2	100,0	18,0
2024-09-13	09:11:46	068:25:01	0,121	20,0	-94,6	20,2	20,3	20,2	20,2	20,2	100,0	18,0
2024-09-13	09:16:46	068:30:01	0,121	20,0	-93,9	20,1	20,3	20,2	20,1	20,2	100,0	17,9
2024-09-13	09:21:46	068:35:01	0,122	20,0	-95,1	20,1	20,3	20,1	20,1	20,2	100,0	17,9
2024-09-13	09:24:57	068:38:12	Betriebsart: Stopp - Programm - Nachtrocknen									
2024-09-13	09:25:01	068:38:16	Betriebsart: Standby - Manuell - Gefrieren									

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	49 / 50	

**Martin Christ GmbH
LSCplus
Ereignis 24091001.00**



2024-09-13	09:26:46	068:40:01	1000	19,3	-75,9	20,3	20,5	20,3	20,4	20,3	100,0	18,2	
2024-09-13	09:30:01	068:43:16	Betriebsart: Run - Abtauen										
2024-09-13	09:31:46	068:45:01	1000	22,0	-42,4	---	---	---	---	---	---	---	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aufzeichnungsbeginn:	2024-09-10 12:46:45	Aufzeichnungsende:	2024-09-13 9:35:41	Aufzeichnungsdauer (hhh:mm:ss):	68:48:55
Produkt-Nr.:	\pdaconservative		Produkt-Name:		
Batch-Nr.:			Batch-Name:		
Batch-Größe:			Batch Volumen pro Einheit:		
Notiz:					
Dokument erstellt am:	2024-09-18 09:46:51	LPCplus	Unterschrift:		
Dokument erstellt von:			Seite:	50 / 50	